



**table des matières**  
*inhaltsverzeichnis*  
**indice**  
*table of content*

---

02	introduction	<i>einführung</i>	introduzione	<i>introduction</i>
03	histoire	<i>geschichte</i>	storia	<i>history</i>
04	■ diagnostic	<i>diagnostik</i>	diagnostica	<i>diagnostic</i>
10	■ parodontologie	<i>parodontologie</i>	parodontologia	<i>periodontology</i>
22	■ chirurgie	<i>chirurgie</i>	chirurgia	<i>surgery</i>
30	■ traitement conservateur	<i>zahnerhaltung</i>	trattamento conservativo	<i>restorative</i>
55	nos valeurs	<i>unsere werte</i>	i nostri valori	<i>our values</i>
56	■ accessoires & kits	<i>zubehör &amp; kits</i>	accessori & kits	<i>accessories &amp; kits</i>
62	■ entretien	<i>wartung</i>	manutenzione	<i>maintenance</i>
65	index par article	<i>index pro artikel</i>	indice per articolo	<i>index per article</i>
67	index alphabétique	<i>alphabetischer index</i>	indice alfabetico	<i>alphabetic index</i>
68	comment commander	<i>wie bestelle ich</i>	come ordinare	<i>how to order</i>

## **introduction**

## *einführung*

## **introduzione**

## *introduction*



Manufacture suisse unique en son genre, Deppeler SA fabrique depuis 1934 des instruments dentaires haut de gamme, avec des matériaux exceptionnels et selon des techniques éprouvées.

Spécialisés exclusivement dans la fabrication d'instruments à main, nous avons développé plus de 500 modèles, que nous produisons dans la plus pure tradition suisse.

*Die Deppeler SA ist ein Schweizer Unternehmen der besonderen Art. Seit der Gründung der Firma im Jahre 1934 werden alle unsere Instrumente aus erstklassigen Materialien und mittels erprobten Techniken, hergestellt.*

*Wir haben uns ausschliesslich auf die Herstellung von Handinstrumenten spezialisiert. Im Laufe der Jahre entwickelten wir 500 Modelle, die gemäss reinster schweizerischer Tradition hergestellt werden.*

---

Manifattura svizzera unica nel suo genere, Deppeler SA fabbrica dal 1934 strumenti dentali di alta qualità, con materiali eccezionali e secondo tecniche comprovate.

Specializzati esclusivamente nella fabbricazione di strumenti manuali, abbiamo sviluppato più di 500 modelli, che vengono prodotti nella più pura tradizione svizzera.

*A Swiss manufacturer in a class of its own, Deppeler SA has been making top-of-the-range dental instruments, using outstanding materials and tried and tested techniques, since 1934.*

*Specialising exclusively in the manufacture of hand instruments, we have developed more than 500 models, which we produce according to the strictest Swiss tradition.*

---

***Serious instruments for serious work!***





**Diane Bonny**  
CEO

**histoire**  
**geschichte**  
**storia**  
**history**

---

Dès 1934, Arnold Deppeler Senior, créateur éponyme de la manufacture, fabriqua ses premiers instruments dans son garage, à Rolle. Bien vite, ils furent connus dans tout le pays comme une référence de qualité.

En collaboration avec d'éminents médecins-dentistes, son fils, Arnold Deppeler Junior, conçut et développa le M23™, révélation sur le marché dentaire, où il s'implanta mondialement, à l'image du couteau suisse.

Depuis sa création, la société, reprise en 2007 par Diane Bonny, ne cessa de croître. En 2008, l'industrie déménagea dans de nouveaux locaux, caractérisés par des conditions optimales de travail et un grand respect de l'environnement.

*Seit 1934 produzierte Arnold Deppeler Senior, Namensgeber der Manufaktur, seine ersten Instrumente in seiner Garage in Rolle. Schnell wurden diese im ganzen Land bekannt für ihre hohe Qualität.*

*Die enge Zusammenarbeit mit renommierten Zahnärzten ermöglichen seinem Sohn, Arnold Deppeler Junior, anfangs der 60er-Jahre, die Entwicklung des M23™. Das Instrument galt als die Offenbarung auf dem Dentalmarkt und konnte sich im Laufe der Jahre, dem Schweizer Armeemesser gleich, weltweit durchsetzen.*

*Seit der Gründung ist das Unternehmen, das 2007 von Frau Diane Bonny übernommen wurde, ununterbrochen gewachsen. 2008 zog das Unternehmen in ein Gebäude um, das optimale Arbeitsbedingungen bietet und auch vom energetischen Standpunkt aus gesehen hohe Qualitäten aufweist.*

---



Fin dal 1934, Arnold Deppeler Senior, creatore eponimo della manifattura, fabbricò i suoi primi strumenti nel suo garage, a Rolle. Ben presto, questi ultimi divennero un riferimento di qualità nell'intero paese.

In collaborazione con noti medici-dentisti, suo figlio, Arnold Deppeler Junior, concepì e sviluppò il M23™. Questo strumento fu una vera e propria rivelazione nel mercato dentale, tanto da divenire mondialmente riconosciuto quanto il famoso coltellino svizzero.

Fin dalla sua creazione, la società, guidata nel 2007 da Diane Bonny, non smise di espandersi. Nel 2008, l'industria si trasferì in nuovi stabilimenti caratterizzati da ottime condizioni di lavoro e da un grande rispetto dell'ambiente. Pochissime imprese possono vantarsi, come noi, di fabbricare i propri prodotti in stabilimenti a marchio Minergie.

*In 1934, Arnold Deppeler Senior, eponymous founder of the company, produced his first instruments in his garage in Rolle. They soon became known throughout the country, as a benchmark for quality.*

*In collaboration with respected dentists, his son, Arnold Deppeler Junior, designed and developed the M23™ scaler, which proved a hit on the dental market, becoming a globally recognised product, just like the Swiss Army Knife.*

*Since its creation, the company, led, since 2007, by Diane Bonny, has undergone constant expansion. In 2008, the firm moved to new premises, which offer ideal working conditions and an environmentally sound setting.*

---

**diagnostic**  
*diagnostik*  
*diagnostica*  
*diagnostic*

<b>05</b>	<b>Sondes</b>	<i>Sonden</i>	<i>Sonde</i>	<i>Explorers</i>
05	> Sondes simples	> <i>Einendige Sonden</i>	> Sonde singole	> <i>Single-end explorers</i>
05	> Sondes doubles	> <i>Doppelendige Sonden</i>	> Sonde doppie	> <i>Double-end explorers</i>
<b>06</b>	<b>Sondes parodontales</b>	<i>Paro Sonden</i>	<b>Sonde parodontali</b>	<i>Periodontal probes</i>
06	> Sonde à implants	> <i>Implantat Sonde</i>	> Sonda per impianti	> <i>Implant probe</i>
06	> Sondes gravées	> <i>Eingeritzte Sonden</i>	> Sonde incise	> <i>Engraved probes</i>
07	> Sondes colorées	> <i>Farb-Markierte Sonden</i>	> Sonde colorate	> <i>Color coded probes</i>
<b>08</b>	<b>Sondes à furcations</b>	<i>Furkations Sonde</i>	<b>Sonde per forzazioni</b>	<i>Furcations probes</i>
08	<b>Brucelles</b>	<i>Pinzetten</i>	<b>Pinzette</b>	<i>Tweezers</i>



“Their exceptional, hand-finished instruments have, thanks to their highest processing quality, a rarely long durability and give me a daily pleasure in my specialty practice.”

*Dr. Jean-Pierre Ebner*

**Sondes****Sonden****Sonde****Explorers**

&gt; Sondes simples

*Einendige Sonden*

Sonde singole

*Single-end explorers*

Nos sondes sont fabriquées en acier inox trempé. Elles gardent leurs formes et leurs extrémités pointues pour une longue durée.

Unsere Sonden sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl hergestellt. Sie halten ihre Form und Schärfe für eine lange Zeit.

Le nostre sonde sono fabbricate in acciaio inossidabile temperato e mantengono la forma e le estremità appuntite per un periodo molto lungo.

Our hard-wearing, resilient explorers, made of hardened stainless steel, will retain their sharpness and shape for a long time.

&gt; Sondes doubles

*Doppelendige Sonden*

Sonde doppie

*Double-end explorers*

>  
Résistant-flexible  
*Flexibel-widerstandsfähig*  
Resistente-flessibile  
*Resilient-flexible*

>  
Pointu  
*Scharf*  
Aguzzo  
*Sharp*

**DH2<sup>TM</sup> & DH3**

>  
Pour la recherche du tartre sub-gingival.  
*Für die sub-gingivale Zahnstein-Untersuchung.*  
Per la ricerca del tartaro sub-gengivale.  
*For pocket calculus detection.*



>  
DH2=angl. Gracey 11/12  
DH3=angl. Gracey 13/14

**Sondes parodontales****Paro Sonden****Sonde parodontali****Periodontal probes**

- > Sonde à implants

- Implantat Sonde*

- Sonda per impianti

- Implant pocket probe*



**PERITITAN PROBE**  
Prof. Dr. K. H. Rateitschak  
**PP12**  
3-6-9-12 mm



**PP12DMS**

Pointe parfaitement arrondie.

Cette sonde a été développée pour le sondage autour des implants en titane, mais elle est également parfaitement adaptée au sondage des poches autour des dents naturelles. En effet, étant souple, elle suit la courbure de la racine et grâce à son élasticité, retrouve sa forme rectiligne après usage. La matière plastique utilisée permet un retraitement en toute sécurité. La graduation est indélébile et restera parfaitement lisible tout au long de sa vie. La pointe et le manche sont stérilisables (200° C).

- > Présentation: 3 pointes à visser PP12 + 1 manche en plastique vert DMS.

Perfekte abgerundete Spitze

Diese Sonde wurde für Arbeiten rund um die Titanimplantate entwickelt, ist aber auch für die Taschen rund um die natürlichen Zähne bestens geeignet. Da sie biegsam ist, folgt sie der Krümmung der Wurzel und kehrt dank ihrer Elastizität nach Gebrauch wieder in ihre gerade Form zurück. Der in unseren Werkstätten verwendete Kunststoff ermöglicht eine sichere Wiederaufbereitung. Die Einteilung ist permanent und bleibt während der gesamten Lebensdauer perfekt lesbar. Die Spitze und der Griff sind perfektionsmäßig legible für die gesamte Lebensdauer. Die Spitze und der Griff sind sterilisierbar (200° C).

- > Präsentation: 3 Spitzen zum Einschrauben PP12 + 1 Griff aus grünem Plastik DMS.

Punta perfettamente arrotondata

Questa sonda è stata sviluppata per il sondaggio attorno agli impianti in titanio, ma è anche perfettamente adatta al sondaggio delle tasche attorno ai denti naturali. In effetti, la sua flessibilità le permette di seguire la curva della radice per ritrovare la sua forma dopo l'uso. La materia plastica utilizzata, scelta dai nostri laboratori, permette un ritrattamento in tutta sicurezza. La graduazione è indelebile e rimane perfettamente leggibile per tutta la vita dello strumento. Sterilizzabile fino a 200° C.

- > Confezione: 3 sonde a vite PP12 + 1 manico in plastica verde DMS.

Perfectly rounded tip.

This probe was developed for probing around titanium implants, but is also perfectly suited to probing periodontal pockets on natural teeth. As it is pliable, it follows the curve of the root, but its flexibility enables it to return to its original shape after use. The plastic used by our workshops ensures safe treatment time and again. The marking is indelible and will remain perfectly legible throughout the instruments' life. They are sterilizable (200° C).

- > Delivery: 3 screw tips PP12 + 1 green plastic handle DMS.

- > Sondes gravées

Eingeritzte Sonden

Sonde incise

Engraved probes

ø 0.45 mm ø 0.45 mm

ø 0.60 mm



- >  
Pointes parfaitement arrondies  
Perfekt abgerundete Spitzen  
Punte perfettamente arrotondate  
Perfectly rounded ends



**ZI8A**

- >  
3-6-8 mm

**GE8**

- >  
3-6-8-10 mm

**ZI8**

- >  
3-6-9 mm

**SE3 & SE4**

- >  
Sondes spatules  
Spatel Sonden  
Sonde piatte  
Spatula probes  
1-2-3-5-7-8-9-10 mm

**Sondes parodontales*****Paro Sonden*****Sonde parodontali*****Periodontal probes*****> Sondes colorées**

Nos sondes parodontales, en acier inox trempé, allient flexibilité et résistance. Le marquage couleur tient pour des années.

**Farb-markierte Sonden**

Unsere Paro Sonden, aus gehärtetem, rostfreiem Stahl hergestellt, sind flexibel und widerstandsfähig. Die Farbmarkierung hält für Jahre.

**Sonde colorate**

Le nostre sonde parodontali, in acciaio inossidabile, sono flessibili e resistenti. La calibrazione colorata delle sonde rimane inalterata nel lungo periodo.

**Color coded probes**

Our Perio Probes, made of hardened stainless steel, combine flexibility and resilience. The colour coding will last for years.



HH12DMS

**DMS****>**

Manche DMS en plastique vert ou noir  
DMS Plastik-Griff, Farbe grün oder schwarz

Manico DMS in plastica verde o nero  
Green or black DMS plastic handle  
p. 61

**>**

Pointe à vis  
Spitze zum Einschrauben  
Attacco a vite  
Screw tip

HH12 (H12)  
HH12DMS

3-6-9-12 mm  
ø 0.48 mm

GY12 (G12)  
GY12 DMS

Günay  
1-2-3.5-5.5-8.5-11.5 mm  
ø 0.50 mm

HH11 (H11)  
HH11DMS

3-6-8-11 mm  
ø 0.48 mm

DHB11 (D11)  
DHB11DMS

3-6-8-11 mm  
ø 0.50 mm

DHZ12 (D12)  
DHZ12DMS

3-6-9-12 mm  
ø 0.48 mm

KHR12 (K12)  
KHR12DMS

3-6-9-12 mm  
ø 0.50 mm

PP12  
PP12DMS

3-6-9-12 mm  
ø 0.50 mm

WHO (W)  
WHODMS

3.5-5.5-8.5-11.5 mm  
ø 0.50 mm




**>**  
Pointes parfaitement arrondies  
Perfekt abgerundete Spitzen  
Punte perfettamente arrotondate  
Perfectly rounded ends




H125

2-5-10 mm

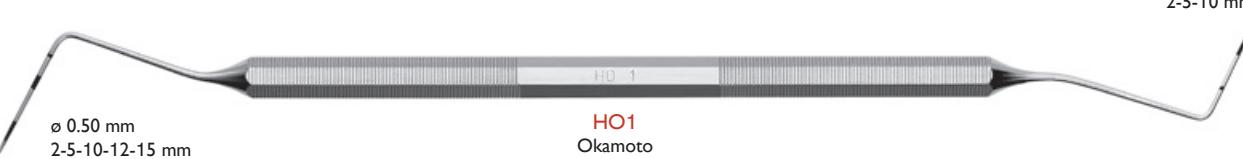HO1  
Okamoto

**Sondes à furcations****Furkations Sonden****Sonde per forzazioni****Furcations probes**

Nabers Probe

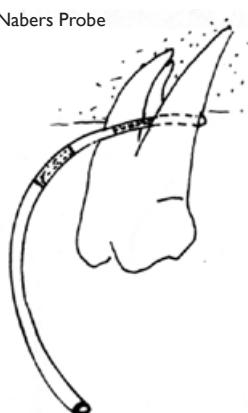

NP2C

>  
3-5 mm

ZA2

>  
2-4-6-8 mm

ZA3

>  
3-6-9-12 mm

ø 0.40 mm

ø 0.50 mm

ø 0.50 mm

ø 0.50 mm

HO2  
Okamoto

NP2C

ZA2

ZA3

**Brucelles****Pinzetten****Pinzette****Tweezers**

Deppeler

EZI70

P20

Meriam

P96

College

P10

College

P15

EZI70 &amp; P20

>  
Pincettes fortes  
Starke Pinzette  
Modello robusto  
Strong tweezers

P15

>  
Pointes diamantées pour une meilleure préhension  
Diamantierte Spitzen für besseres Greifen  
Punte diamantate per una migliore presa  
Diamond-tipped for better prehension

# M23 l'Original



**The M23™ frequently copied, but never equalled**

#### M23 "L'ORIGINAL"

Grâce à son angulation révolutionnaire, le M23 développé par DEPPELER™ SA permet de travailler tout autour de la dent; et ceci aussi bien pour les molaires/prémolaires que pour les incisives.

Le M23 de Deppeler, souvent copié, jamais égalé!

#### M23 "L'ORIGINAL"

Dank des revolutionären Winkels des M23, entwickelt von DEPPELER™ SA, ist es möglich, rundum des Zahnes zu arbeiten, sei es Prämolaren/Molaren oder Frontzähne.

M23 von Deppeler - oft kopiert, nie erreicht!

#### M23 "L'ORIGINAL"

Grazie alla sua angolazione rivoluzionaria, l'M23 sviluppato da DEPPELER™ SA permette di lavorare intorno ai denti in maniera efficace, sia a livello dei molari e premolari che di incisivi.

L'M23 di Deppeler, spesso copiato, mai uguagliato!

#### M23™ "L'ORIGINAL"

Thanks to its revolutionary angle, the M23™ developed by DEPPELER™ SA it is possible to work all round the tooth; both molars/pre-molars and incisors.

The M23 by Deppeler, frequently copied, never equalled!

#### Pourquoi Deppeler ?

1. Spécificités et caractéristiques de NOTRE matière première,
2. Maîtrise totale de tous les traitements de la matière première, intégralement effectués par nos soins en interne,
3. Finition manuelle des lames,
4. Parfaite maîtrise de la géométrie d'un tranchant d'instrument dentaire,
5. Géométries développées pour une utilisation optimale et un ratio: force requise / travail de la lame imbattable,
6. Formes parfaitement reproduites grâce à des tolérances de fabrication serrées.

#### Wieso Deppeler ?

1. Besonderheiten und Merkmale unseres Rohstoffes,
2. Vollständige Beherrschung aller Rohstoffbehandlungen, die vollständig intern durchgeführt werden,
3. Von Hand ausgeführte Endverarbeitung der Klingen,
4. Perfekte Beherrschung der Schneidegeometrie eines zahnmedizinischen Instruments,
5. Für eine optimale Verwendung entwickelte Formen mit unschlagbarem Verhältnis zwischen Kraftaufwand und Wirkung der Klinge und
6. Perfekt nachgebildete Formen dank geringer Herstellungstoleranzen.

#### Perché Deppeler ?

1. Specificità e caratteristiche della NOSTRA materia prima,
2. Totale padronanza di tutti i trattamenti sulla materia prima, interamente effettuati da noi al nostro interno,
3. Rifinitura manuale delle lame,
4. Perfetta padronanza nella finitura del taglio degli strumenti,
5. Geometrie sviluppate per un utilizzo ottimale ed un imbattibile rapporto:forza richiesta e lavoro della lama,
6. Forme riprodotte perfettamente grazie a strette tolleranze di fabbricazione.

#### Why Deppeler?

1. The special qualities of OUR raw material,
2. Full control of all stages in the processing of the raw material, which is carried out internally by our in-house staff,
3. Hand-finished blades,
4. Faultless expertise in shaping the cutting edge of a dental instrument,
5. Forms developed for optimal use and an unbeatable force/blade-effectiveness ratio,
6. Perfectly reproduced forms thanks to strict manufacturing margins.



>

Nouveau avec son manche encore plus ergonomique et 100% hygiénique.  
Neu mit seinem noch ergonomischer Griff und 100% hygienisch.  
Con il suo nuovo manico ancora più ergonomico ed igienico al 100%.  
New with its still more ergonomic handle and 100% hygienic.

**CLEANext**  
Technology



Nouveau Manche : disponible pour

Neuer Griff : verfügbar für

Nuovo manico : disponibile per

New handle : available for

M23CN, M23ACN & Gracey Classic. (5GE6CN, 7GE8CN, 11GE12CN, 13GE14CN) p.21

**parodontologie**  
*parodontologie*  
**parodontologia**  
*periodontology*

11	Scalers	Scalers	Scaler	Scalers
11	> Scalers	> Scalers	> Scaler	> Scalers
12	> Scalers fins	> Feine Scalers	> Scaler fini	> Fine scalers
12	> Lingual scalers	> Lingual Scalers	> Scaler linguali	> Lingual scalers
12	> Back action ciseaux	> Back Action Meissel	> Scalpelli back action	> Back action chisels
13	Curettes universelles	Universal Küretten	Curette universali	Universal curettes
13	> M23A	> M23A	> M23A	> M23A
13	> Curettes	> Küretten	> Curette	> Curettes
13	> Curettes de Langer	> Langer Küretten	> Curette di Langer	> Langer curettes
14	> Curettes fines	> Feine Küretten	> Curette fini	> Fine curettes
14	> Furcations	> Furkationen	> Forcazioni	> Furcations
15	> Curettes à implants	> Implants Küretten	> Curette per impianti	> Implant curettes
16	> Curettes diamantées	> Diamantierte Küretten	> Curette diamantate	> Diamond-coated curettes
17	Gracey curettes	Gracey Küretten	Curette Gracey	Gracey curettes
17	> Classic	> Classic	> Classic	> Classic
18	> Atraumatic	> Atraumatic	> Atraumatic	> Atraumatic
18	> Mini profil	> Mini Profil	> Mini profil	> Mini profil
19	> Nano profil	> Nano Profil	> Nano profil	> Nano profil
19	> Rigides	> Starre	> Rigiide	> Rigid
20	Houes	Hauen	Zappette	Hoes
20	Limes	Feilen	Lime	Files
21	Nouveaux manches CLEANext	Neue Griffen CLEANext	Nuovi manici CLEANext	New handles CLEANext



## Ergonomie

&gt;

Tous nos instruments peuvent être commandés avec des manches ergonomiques en silicium médical, voir p. 61.  
*Alle unsere Instrumente können mit den ergonomischen Silikon Griffen bestellt werden, S. 61.*  
*Tutti i nostri strumenti possono essere ordinati con i manicotti ergonomici in silicone, p. 61.*  
*All our instruments can be ordered with our ergonomic silicone sleeves, see p. 61.*



**Scalers**

La maîtrise de la matière première confère à nos scalers non seulement un tranchant incomparable, mais aussi une très grande résistance à l'usure.

**Scalers**

Unser Knowhow des Rohstoffes gewährt unseren Scaltern eine einzigartige Schärfe aber auch eine lange Lebensdauer.

**Scaler**

La nostra maestria nel trattamento della materia prima garantisce ai nostri scalers non solo un taglio incomparabile, ma anche una lunga resistenza all'usura.

**Scalers**

Our mastery of the raw material not only gives to the instruments their incomparable cut, but also an extremely hard-wearing.

> Scalers simples

*Einendige Scalers*

Scaler singoli

*Single-end scalers*



> Scalers doubles

*Doppel-endige Scalers*

Scaler doppi

*Double-end scalers*



M23™

>  
AD33, M21, RZI11L  
interproximal  
approximal  
interproximale  
approximal

>  
GX1, PY151, HP551, H533  
Incisives  
Front Zahne  
Incisivi  
Incisives

>  
14SPY13S, M15, H6H7, AP67  
angl. gauche-droite, prémolaires, molaires  
Winkel links-rechts, Premolare, Molare  
angl. sinistra-destra, premolari, molari  
angl. left-right, premolars, molars

**Scalers**

## &gt; Scalers fins

Ces scalers particulièrement fins permettent un travail très délicat.

**ATTENTION:** non seulement la lame, mais toute la tige est plus fine. Cette géométrie offre une plus grande sensibilité dans le travail.

**Scalers***Feine Scalers*

Diese Scalers sind besonders fein und erlauben so ein äusserst delikates Arbeiten.

**ACHTUNG:** Nicht nur die Klinge, sondern der ganze Schaft ist dünner. Diese Form bietet eine bessere Sensibilität bei der Arbeit.

**Scaler**

## Scaler fini


Questi scaler particolarmente fini permettono un lavoro molto delicato.

**ATTENZIONE:** non solo la lama, ma l'intera asta è più fine. Questa geometria garantisce una maggior sensibilità nel lavoro.

**Scalers***Fine scalers*

These special fine scalers make it possible to carry out extremely delicate work.

**IMPORTANT:** it is not just the blade which is finer, but the entire shaft. This design allows greater sensitivity in your work.

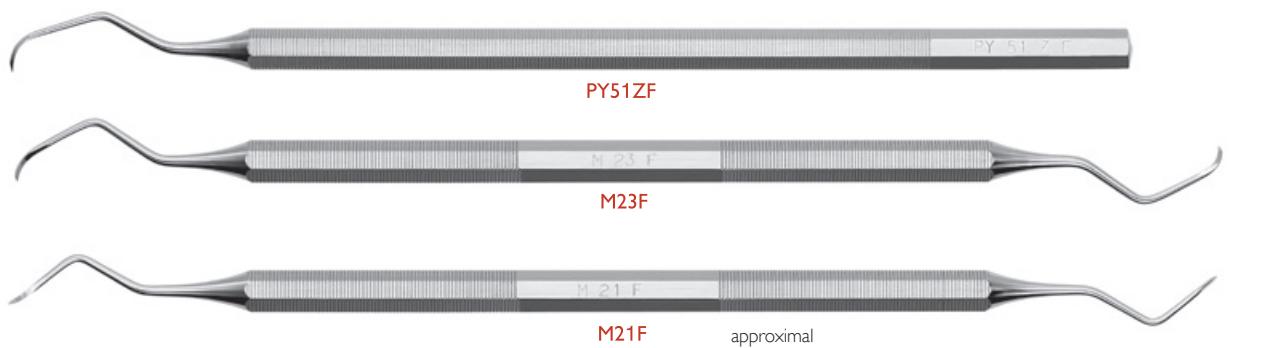

## &gt; Lingual scalers

*Lingual Scalers*


## Scaler linguali

*Lingual scalers*

## &gt; Back action ciseaux

*Back Action Meissel*

## Scalpelli back action

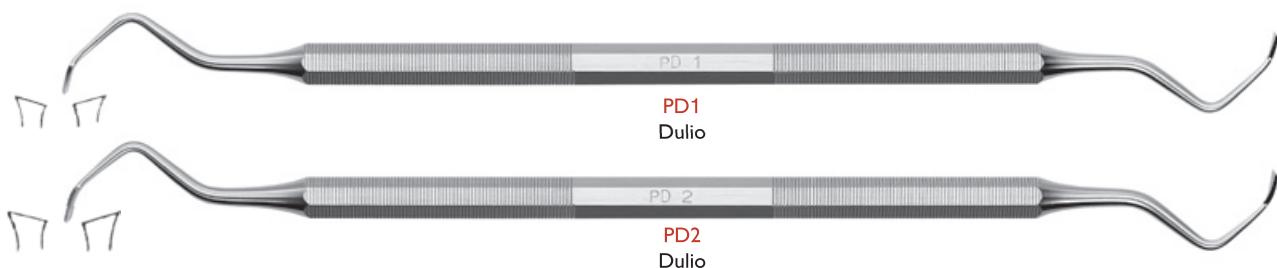*Back action chisels*

**Curettes universelles***Universal Kurette***Curette universali***Universal curettes*> M23A<sup>TM</sup>*M23A<sup>TM</sup>*M23A<sup>TM</sup>*M23A<sup>TM</sup>*

&gt; Incisives, Canines

*Frontzähne*

Incisivi, Canini

*Incisors, Canines*

&gt; Prémolaires, Molaires

*Prämolaren, Molaren*

Premolari, Molari

*Premolars, Molars*

&gt; Curettes de Langer

*Langer Küretten*

Curette di Langer

*Langer curettes*

**Curettes universelles*****Universal Kuretten*****Curette universali*****Universal curettes***

## &gt; Curettes fines

Ces curettes particulièrement fines permettent un travail très délicat.

**ATTENTION:** non seulement la lame, mais toute la tige est plus fine. Cette géométrie offre une plus grande sensibilité dans le travail.

**Feine Kuretten**

Diese Kuretten sind besonders fein und erlauben so ein äußerst delikates Arbeiten.

**ACHTUNG:** Nicht nur die Klinge, sondern der ganze Schaft ist dünner. Diese Form bietet eine bessere Sensibilität bei der Arbeit.

**Curette fini**


Queste curette particolarmente fini permettono un lavoro molto delicato.

**ATTENZIONE:** non solo la lama, ma l'intera asta è più fine. Questa geometria garantisce una maggior sensibilità nel lavoro.


**Fine curettes**

These special fine curettes make it possible to carry out extremely delicate work.

**IMPORTANT:** it is not just the blade which is finer, but the entire shaft. This design allows greater sensitivity in your work.

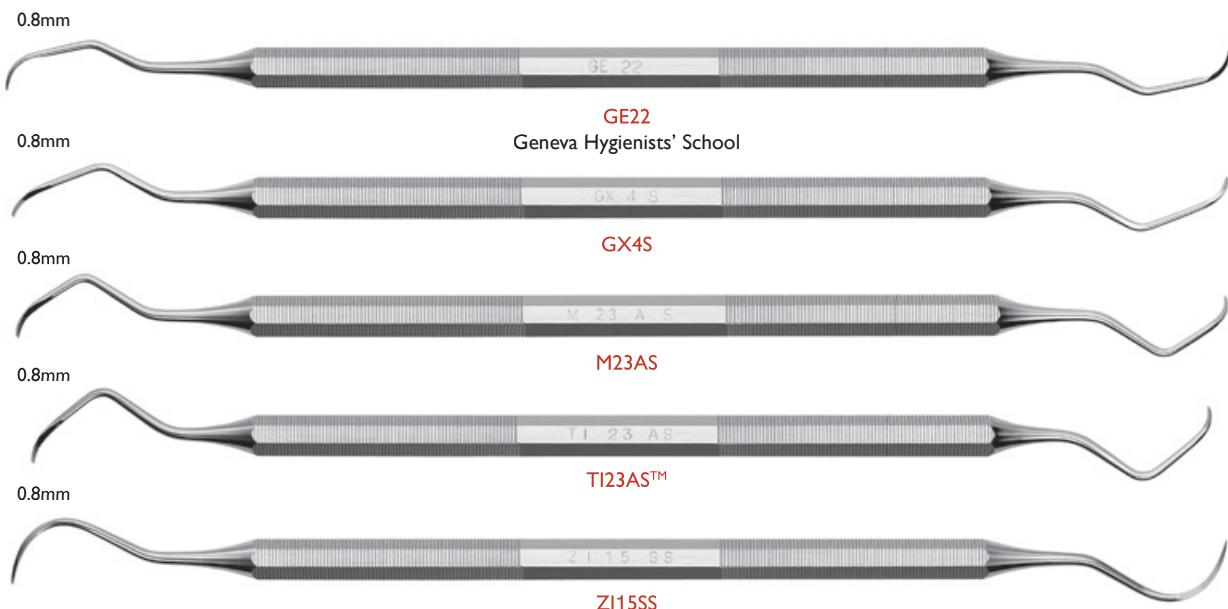

## &gt; Furcations

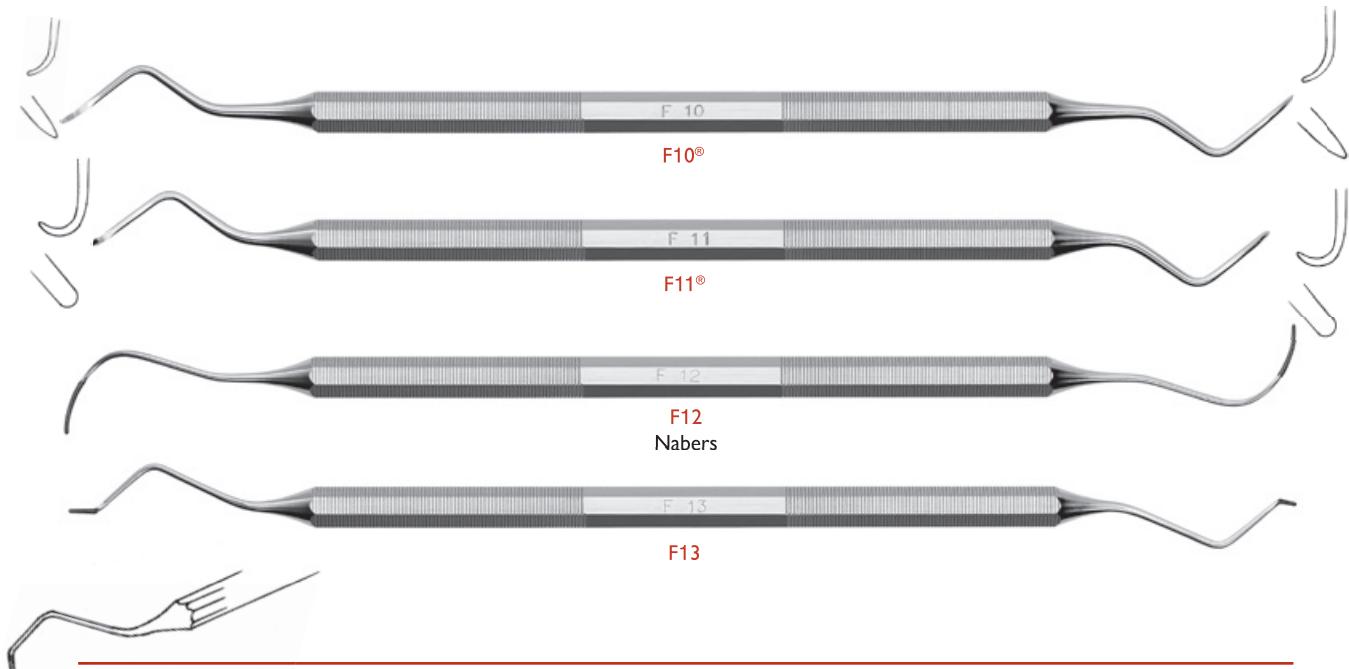**Furkationen****Forcazioni*****Furcations***

- > 2 étapes pour des furcations propres :
  1. curetage avec curette en acier F10 ou F11 selon la taille de la furcation (F10 : légèrement ouverte; F11 : largement ouverte).
  2. Lissage avec curette diamantée F12 ou F13 selon la forme de la furcation. Diamantage extra-fin pour ne pas endommager la zone.

2 Etappen für saubere Furkationen :  
 1. Kurettage mit Stahl-Kuretten F10 oder F11, je nach grösse der Furkation (F10 : leicht offen, F11 : weit offen)  
 2. Glättung mit einer diamantierten Kurette F12 oder F13 je nach Form der Furkation. Die Diamantierung ist extra fein um die Zone nicht zu zerkratzen.

2 passaggi per forcazioni pulite :  
 1. curettage con curette in acciaio F10 o F11 secondo l'ampiezza della forcazione (F10 : leggermente aperta, F11 : largamente aperta)  
 2. lucidatura con curette diamantate F12 o F13 secondo la forma della forcazione. Diamantatura finissima per non danneggiare le superfici.

2 steps for clean furcations :  
 1. curettage with steel curettes F10 or F11 depending of the size of the furcation (F10 : slightly open, F11 : wide open)  
 2. smoothing with diamond coated curettes F12 or F13 depending of the form of the furcation. Very fine diamond grain to not damage the zone.

**Implants**

&gt;

**Pourquoi le titane?****Implantate**




&gt;

**Wieso Titanium?****Impianti**

&gt;

**Perché il titanio?****Implants**

&gt;

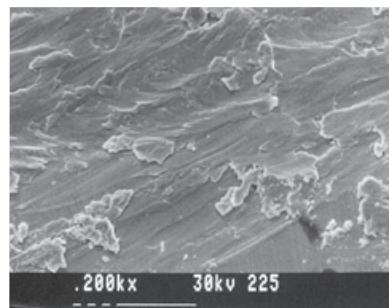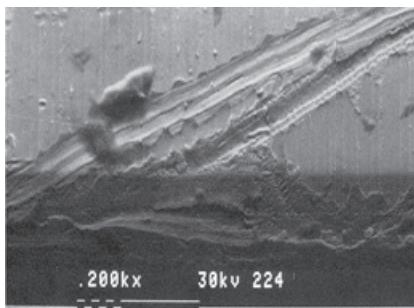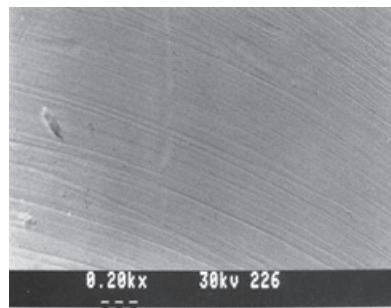**Why titanium?**

&gt;

Le titane est efficace et n'agresse pas l'implant.  
*Titan ist effizient und greift die Implantate nicht an.*  
 Il titanio è efficace e non aggrida l'impianto.  
*Titanium is effective and does not damage implants.*

&gt;

L'acier attaque la surface de l'implant.  
*Stahl greift die Oberfläche eines Implantats an.*  
 L'acciaio incide la superficie dell'impianto.  
*Steel damages the surface of the implants.*

&gt;

Le plastique lisse la plaque au lieu de l'éliminer.  
*Mit Plastik lässt sich Plaque allenfalls glätten, nicht aber eliminieren.*  
 Invece di eliminarla, la plastica liscia la placca.  
*Plastic flattens plaque rather than removing it.*

Les curettes en titane pur (pas de revêtement) permettent le meilleur nettoyage possible de l'implant, sans prendre le risque d'en griffer la surface. La règle est qu'une matière dure ne se fasse pas rayer par une autre matière moins dure.

Pour une longue durée de vie de vos curettes, lisez l'instruction d'entretien p. 62

Kürettens aus reinem Titan (keine Beschichtung) erlauben eine einfache und gründlichere Reinigung der Implantate und verhindern eine Beschädigung der Implantat-Oberfläche durch Kratzer. Es gilt die Regel : ein hartes Material soll sich nicht durch ein anders, weniger hartes Material zerkratzen lassen.  
*Für eine lange Lebensdauer Ihrer Kürettens, lesen sie die Gebrauchsempfehlung S. 62*

Non potendo una materia dura essere incisa da una materia meno dura, le curette in titanio puro (invece di un coating) permettono la migliore pulizia possibile dell'impianto, senza nessun rischio di graffiarne la superficie.

Per una lunga vita delle vostre curette, leggete la modalità d'uso. p. 62

Pure titanium (no coating) curettes ensure the best possible cleaning of the implant without the risk of scratching its surface. The rule is that a hard material cannot be scratched by a material that is less hard.

For a long life of your curettes, read the instruction for use. p. 62

**Le kit parfait pour le traitement des implants***Das perfekte Kit für die Behandlung der Implantate.**Il kit perfetto per il trattamento degli impianti.**The perfect kit for the treatment of the implants.***KITIMPLANT**

&gt;

PP12DMS (+3 recharge tips) Pocket probe (3-6-9-12mm) & curettes AD23LDMS & AD23RDMS, TI67LDMS & TI67RDMS  
 p. 58

**Source :**

Mengel et al, An in vitro study of the treatment of implant surfaces with different instruments. Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13:91-96

**Curettes universelles**

- > Curettes à implants

***Universal Küretten***

- Implantat Küretten*

**Curette universali**

- Curette per impianti

***Universal curettes***

- Implant curettes*



AD23

&gt;

Sa forme, reprise du M23, permet un travail sur toutes les faces.  
*Dank ihrer Form, übernommen vom M23, kann an allen Flächen gearbeitet werden.*

La sua forma, ripresa dal M23, permette un lavoro su tutte le superfici.  
*Its shape, copied from the M23, allows work on all faces.*

AD23L®

AD23R®



TI11

&gt;

Pour les faces interproximales  
*Für die interproximalen Flächen*  
*Per le facce interprossimali*  
*To work on the interproximal faces*

TI67

&gt;

Faucille  
*Sichel*  
*Falcetto*  
*Sichel*

TI11LDMS  
TI11RDMSTI67LDMS  
TI67RDMS

TI67L

TI67R

- > Curettes diamantées


PerioDiaCurette*Diamantierte Küretten*PerioDiaCurette*Curette diamantata*PerioDiaCurette*Diamond coated curettes*PerioDiaCurette

Le grain du diamantage est spécialement étudié pour permettre un travail optimal.

Die Diamantier-Körnung ist speziell dafür studiert um eine optimale Arbeit zu leisten.

La grana della diamantatura è stata studiata appositamente per permettere un risultato ottimale.

Diamond grain is carefully selected to ensure optimal use.

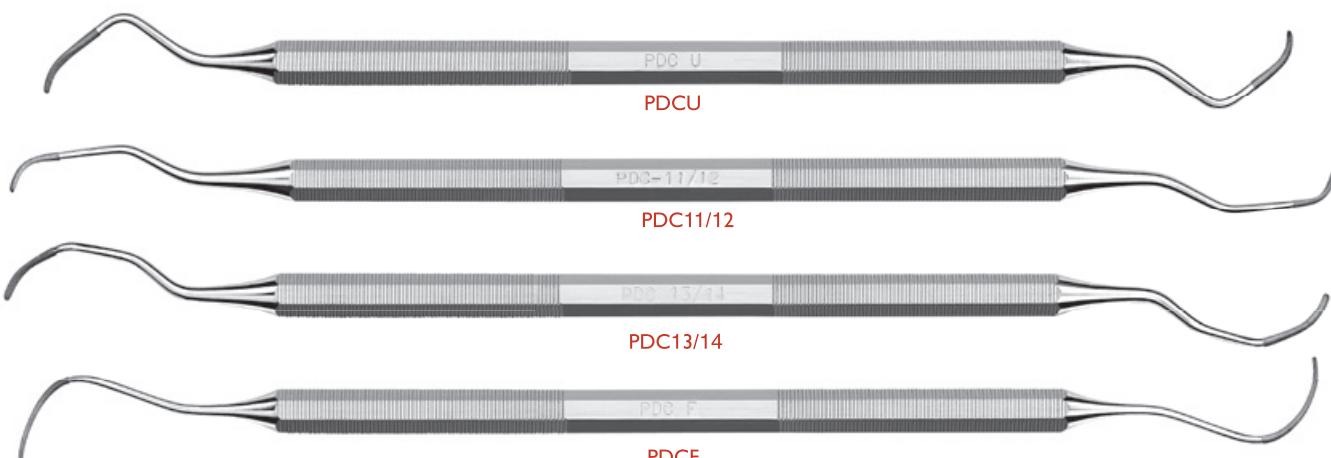

Dans des conditions morphologiques défavorables (sillons radiculaires, concavités radiculaires, furcations), il est difficile d'atteindre une superficie parfaite des racines en utilisant des instruments standards. Les PerioDiaCurette, avec la sensibilité tactile incomparable des instruments manuels, permettent une amélioration du traitement dans les situations susmentionnées.

Unter erschwerten morphologischen Bedingungen (Wurzeleinziehungen, Wurzelkonkavitäten, Furkationen) ist es schwierig, eine perfekte Oberfläche der Wurzel mit Standardinstrumenten zu erreichen. Die PerioDiaCurette, mit der unvergleichlichen taktilen Sensibilität von Handinstrumenten, ermöglichen eine perfektionierte Behandlung in den vorgenannten Situationen.

In condizioni morfologiche sfavorevoli (solchi, concavità, forzazioni) è difficile raggiungere una perfetta lucidatura delle superfici radicolari utilizzando strumenti standard. Le PerioDiaCurette, grazie alla ineguagliabile sensibilità tattile offerta dagli strumenti manuali e alle estremità diamantate a grana ultrafine (15um), consentono un trattamento notevolmente migliorato nelle situazioni descritte.


Under unfavourable morphological conditions (root grooves, root concavities, furcations), it is difficult to achieve a perfect root surface by use of standard instruments. PerioDiaCurette, with their incomparable tactile sensitivity of hand instruments, allow for a highly improved treatment in the above-mentioned situations.

>  
PerioDiaCurette


Dr. Paolo Siervo, Milan, Italie

**Curettes Gracey**

&gt; Classic

**Gracey Küretten***Classic*

>  
Incisives, canines  
*Frontzähne*  
Denti frontali  
*Incisors, canines*

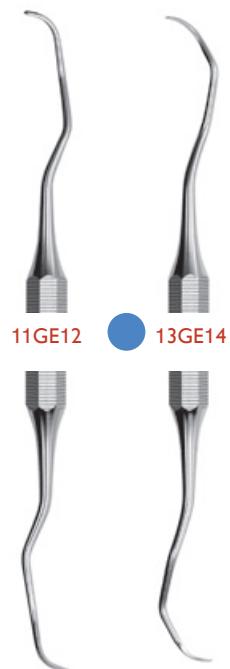**Curette Gracey***Classic***Gracey curettes***Classic*

5/6



>  
Prémolaires, molaires  
*Prämolaren, Molaren*  
Premolari e molari  
*Premolars, molars*

7/8  
BUCCAL /  
PALATAL11/12  
MESIAL13/14  
DISTAL

>  
Tranchant  
Scharfe Kante  
Bordo tagliente  
*Working Edge*

les 5GE6, 7GE8, 11GE12, 13GE14 sont aussi disponibles avec le manche CLEANext, p. 21.

Die 5GE6, 7GE8, 11GE12, 13GE14 sind auch mit dem ergonomischen Griff CLEANext erhältlich, S. 21.


Le 5GE6, 7GE8, 11GE12, 13GE14 sono disponibili anche con il manico ergonomico CLEANext, p. 21.

The 5GE6, 7GE8, 11GE12, 13GE14 are also available with the CLEANext Handle, p.21.



**Curettes Gracey**

&gt; Atraumatic

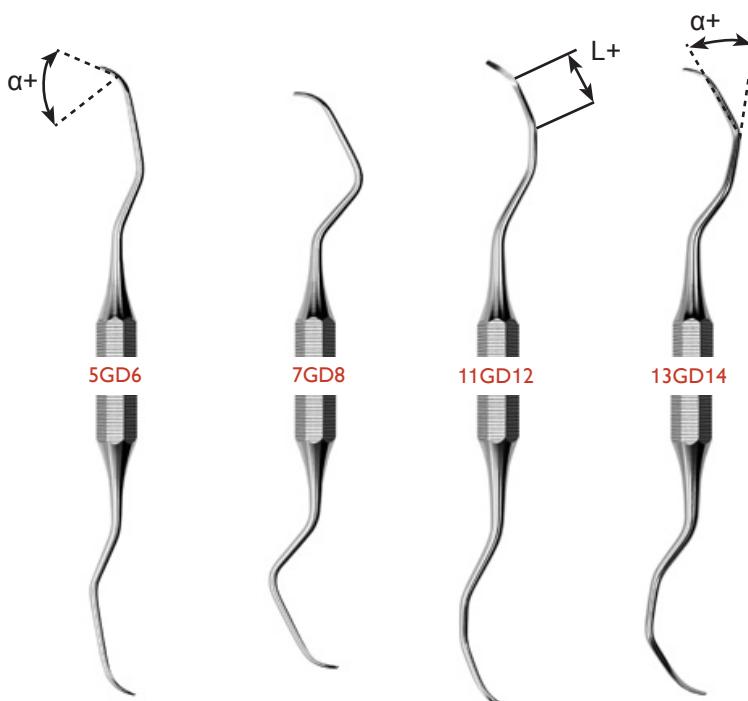

Modèles 5/6-7/8: un angle plus ouvert, assure une pénétration plus aisée et plus profonde.

Modèles 11/12-13/14: tige terminale plus longue, lame plus ouverte, des angles de pliage plus fonctionnels pour une pénétration optimale.

**Gracey Küretten**


Atraumatic

**Curette Gracey**

Atraumatic

**Gracey curettes**

Atraumatic

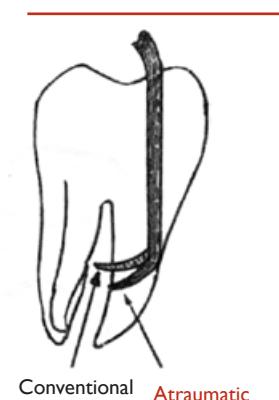

Conventional Atraumatic

&gt;

Nouvelle angulation pour un curetage plus profond.  
Neue Winkelung für eine tiefer Kürettage.  
Nuova angolazione per un curettaggio più profondo.  
New angulation for deep scaling.

&gt; Mini Profil

*Mini Profil**Mini Profil**Mini Profil*

Lames plus courtes et plus fines, angulation des tiges optimale et courbure des lames idéale pour effectuer un curetage peu invasif, épousant le profil et les irrégularités des racines.

Kürzere und feinere Klingen, optimaler Stiel-Winkel und Krümmung der Klingen, sind ideal für eine nicht-invasive Kürrettage, da sie dem Profil und den Unebenheiten der Wurzeln angepasst sind.

Le lame più corte e più fini, una angolazione dei gambi ottimale e una curvatura delle lame ideale, permettono un curettaggio poco invasivo sposando il profilo e le irregolarità delle radici.

Shorter, finer blades, optimal shaft angulation and blade curvature, so are ideal for almost non-invasive curetting, as they closely match root profile and irregularities.



**Curettes Gracey**

&gt; Nano Profil

**Gracey Kuretten***Nano Profil***Curette Gracey**

Nano Profil

**Gracey curettes***Nano Profil***Nano Profil™ Gracey // Prof. Dr. H. Günay, Hannover University**

Leurs lames, très courtes et très fines, permettent un curetage peu invasif et s'adaptent aux moindres irrégularités des racines. De plus, leurs tranchants parfaits leur assurent une grande efficacité.

Die Klingen der Kuretten, die sehr kurz und fein sind, erlauben eine weniger invasive Kurettage und passen sich den kleinsten Unebenheiten der Wurzel an. Ausserdem bietet ihre perfekte Schärfe, con un taglio perfetto che ne assicura una grande efficacia.

Le loro lame, corte e molto fini, permettono un curetage poco invasivo, adattandosi alle più fini irregolarità delle radici dentarie, con un taglio perfetto che ne assicura una grande efficacia.


The short and fine blades of these curettes allow one to make very slight invasive curettage. Further they fit the finest irregularities of the root and the perfect cut offers a high efficiency.




&gt; Rigides

*Starre*

Rigide

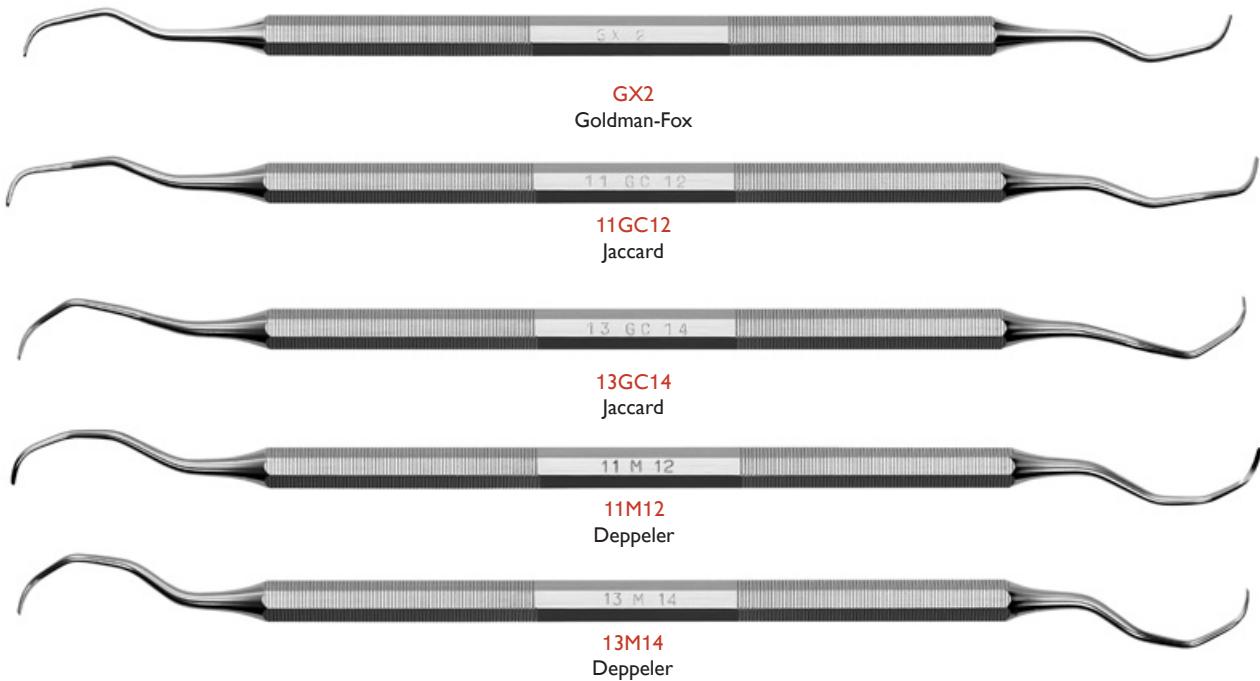*Rigid*

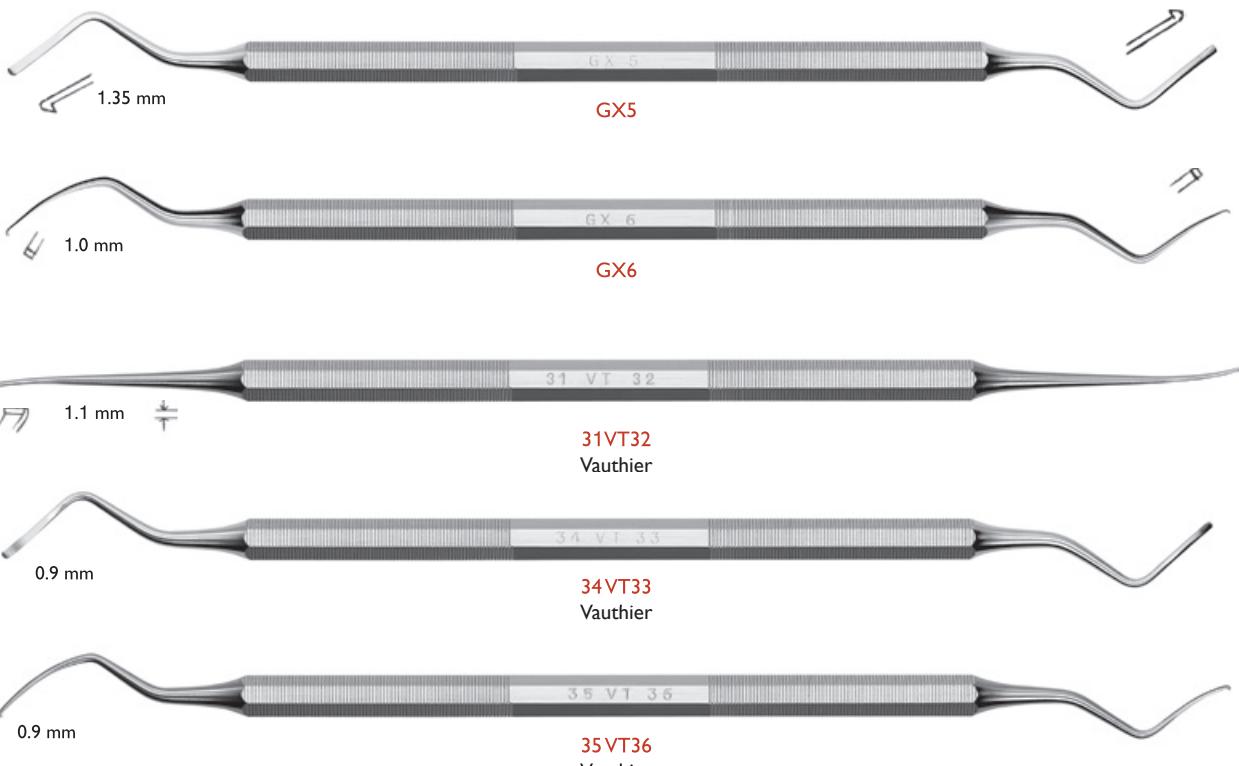**Houes****Hauen****Zappette****Hoes****Limes à lisser les racines**

Ces limes très minces, aux dents très fines, permettent une pénétration aisée et un lissage optimal des racines.

**Feilen zum Wurzelglätten**


Diese sehr dünnen, fein gezahnten Feilen erlauben ein leichtes Eindringen und ein optimales Glätten der Wurzel.

**Lime per lisciare le radici**

Lime molto sottili e con dentatura fine per una facile penetrazione e lucidatura delle superfici radicolari.

**Root finishing files**

Very thin files, with fine teeth for easy penetration and an optimal smoothing of the root.

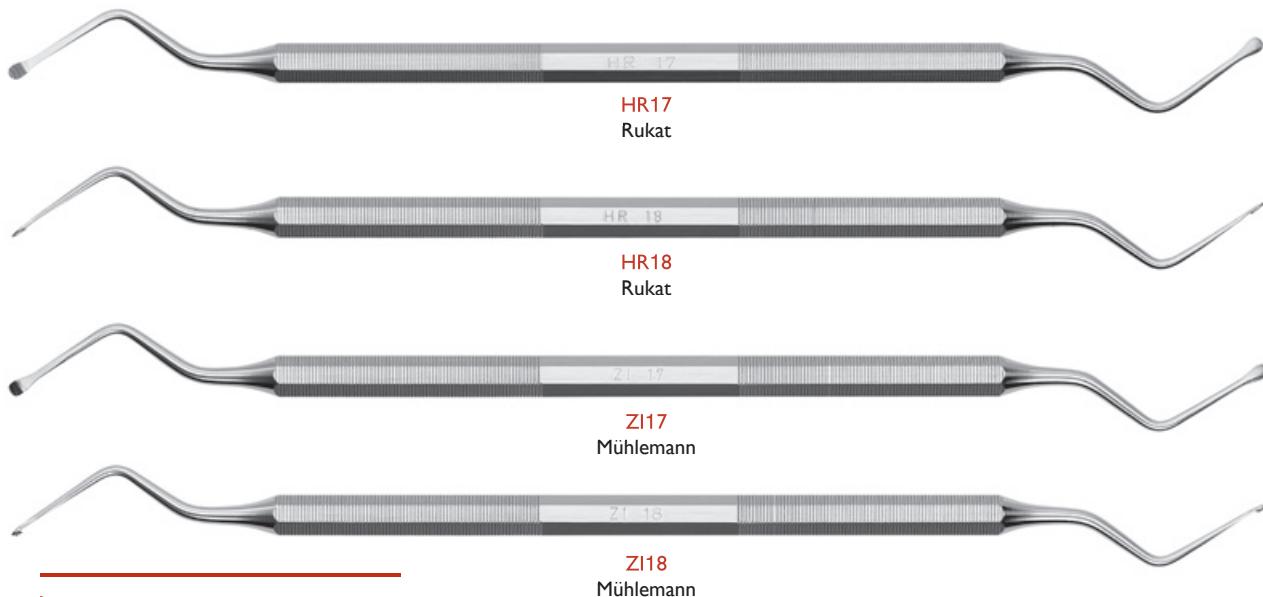

&gt;

HR : lissage des racines ; ZI : détartrage  
 HR : Glättung der Wurzel ; ZI : Zahsteinentfernung  
 HR : lisciare le radici ; ZI : detartraggio  
 HR : root planing ; ZI : scaling



# CLEANext technology

## Manche CLEANext

## CLEANext Griff

## Manico CLEANext

## CLEANext Handles

Unique sur le marché, ce nouveau manche vous offre la combinaison parfaite de :

- Instruments Deppeler d'une qualité incomparable
- instrument monobloc
- 100% hygiène
- un vrai confort grâce au design ergonomique
- poids idéal et parfait équilibre
- moins de force pour une meilleure efficacité avec un design de "handle-response"

Sterilisable à 134°C.

Einmalig auf dem Markt, diese neue Linie gewährt Ihnen die perfekte Kombination von :

- unschlagbaren Deppeler Instrumente
- monobloc Instrument
- 100% Hygiene
- Komfort für den Anwender dank dem ergonomischen Design
- optimales Gewicht und eine perfekte Balance
- weniger Kraft für bessere Effizienz mit dem "handle-response" Design

Sterilisierbar bis 134°C.

Unico sul mercato, questo nuovo manico offre la combinazione perfetta di :

- imbattibile qualità Deppeler
- strumento monoblocco
- 100% igiene
- un vero comfort con il design ergonomico del manico
- peso ideale ed un equilibrio perfetto
- meno forza per più efficacia con il design "handle-response"

Sterilizzabile a 134°C.

Unique on the market, this new handle offers you the perfect combination of :

- unbeatable Deppeler instruments
- monobloc instrument
- 100% hygiene
- a real comfort for the user thanks the ergonomical design
- optimal lightness and perfect balance
- less power for better efficacy with handle-response design

The handle is autoclavable at 134°C.



>  
100% hermétique  
100% hermetisch  
100% ermetisch  
100% hermetic

>  
ergonomie optimale  
optimale Ergonomie  
ergonomia ottimale  
optimal ergonomy

chirurgie  
chirurgie  
chirurgia  
surgery

<b>23</b>	<b>Periotomes</b>	<b>Periotome</b>	<b>Periotomi</b>	<b>Periotomes</b>
23	> Syndesmotomes	> Desmotome	> Sindesmotomi	> Syndesmotomes
<b>24</b>	<b>Raspatoires</b>	<b>Raspatorien</b>	<b>Scollaperiostio</b>	<b>Periosteal elevators</b>
24	> À papilles	> Für Papillen	> Per papille	> For papillae
24	> Prichard	> Prichard	> Prichard	> Prichard
24	> Sinuslift	> Sinuslift	> Sinuslift	> Sinuslift
<b>25</b>	<b>Curettes chirurgicales</b>	<b>Chirurgische Küretten</b>	<b>Curette chirurgiche</b>	<b>Surgical curettes</b>
25	> Curettes alvéolaires	> Alveolarlöffel	> Cucchiai alveolari	> Spoon-shaped curettes
26	> Curettes fenestrées	> Öhrlöffel	> Cucchiai cavi	> Eyehole-spoons
26	> Curettes planes	> Flache Löffel	> Cucchiai piani	> Flat spoons
<b>27</b>	<b>Limes à os</b>	<b>Knochenfeilen</b>	<b>Lime per osso</b>	<b>Bone files</b>
<b>27</b>	<b>Ciseaux à os</b>	<b>Knochen Meissel</b>	<b>Scalpelli per osso</b>	<b>Bone chisels</b>
<b>27</b>	<b>Râcleur à os</b>	<b>Knochenschaber</b>	<b>Raschietto per osso</b>	<b>Bone scraper</b>
<b>27</b>	<b>Couteaux et lancettes</b>	<b>Gingivektomie Messer</b>	<b>Bisturi parodontali</b>	<b>Periodontal knives</b>
<b>28</b>	<b>Couteaux pour microchirurgie</b>	<b>Micro-Chirurgie Messer</b>	<b>Bisturi per microchirurgia</b>	<b>Micro-surgery knives</b>
<b>28</b>	<b>Mucotomes</b>	<b>Mucotome</b>	<b>Mucotomi</b>	<b>Mucotomes</b>
<b>28</b>	<b>Fouloir à mèche</b>	<b>Tamponstopfer</b>	<b>Portatampone</b>	<b>Gauze plugger</b>
<b>29</b>	<b>Élévateurs</b>	<b>Wurzelheber</b>	<b>Leve</b>	<b>Elevators</b>
29	> Standards	> Standard	> Standard	> Standards
29	> Lames dentelées	> Gezackte Klingen	> Lame dentellate	> Serrated blades



**Periotomes**

La finition manuelle du tranchant permet de réaliser un travail efficace, tout en douceur. Avec ces instruments, vous avez la garantie d'une préparation d'extraction optimale.

**Periotome**

Dank der von Hand ausgeführten Endverarbeitung der Klinge kann wirksam und sanft gearbeitet werden. Mit diesen Instrumenten haben Sie die Garantie einer optimalen Extraktionsvorbereitung.

**Periotomi**

La rifinitura manuale delle lame permette interventi delicati ed efficaci. Questi strumenti garantiscono una preparazione all'estrazione ottimale.

**Periotomes**

The hand-finished cutting edge enables you to work efficiently and gently. These instruments guarantee you the best possible preparation for an extraction.



Lame fine et bombée  
Feine gewöbte Klinge  
Lama fine e bombata  
Fine and rounded blade



TH31 : anterior  
TH30 : posterior



## &gt; Syndesmotomes

*Desmotome*

## Sindesmotomi

*Syndesmotomes*

Ces instruments ont été développés pour sectionner les ligaments avant une extraction. Leur grande qualité de fabrication et leur tranchant incomparables sont garants d'un travail précis et efficace.

**ATTENTION:** ces instruments, délicats, ne doivent en aucun cas être utilisés comme élévateurs.

Diese Instrumente wurden entwickelt, um vor einer Extraktion die Ligamente durchzuschneiden. Ihre hohe Qualität und ihre unverwechselbare Schärfe garantieren ein präzises und effizientes Arbeiten.


**ACHTUNG:** diese feinen Instrumente dürfen keinesfalls als Wurzelheber verwendet werden.

Questi strumenti sono stati studiati per sezionare i legamenti parodontali prima dell'avulsione dentaria. La grande qualità di fabbricazione ed il taglio incomparabile sono garanzia di precisione ed efficacia.

**ATTENZIONE:** questi delicati strumenti non devono assolutamente essere utilizzati come leve.

These instruments have been designed to cut ligaments before an extraction. Their top quality manufacture and their exceptional cutting edge guarantee precise and efficient work.

**CAUTION:** these fine instruments should never be used as elevators.

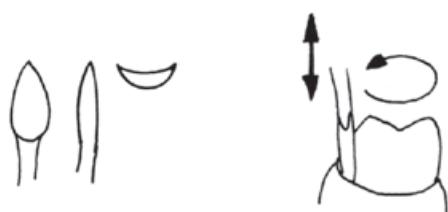

**"Among everything, I love the VT serie for its edge, sharpness and well-considered angles. Especially, angles are very difficult to find the right one, but VT series have the perfect angles."**

*Dr. med. dent. Masaki Kawase,  
Kawase Dental Clinic, Yatomi-city, Japan*




**Raspatoires**



*Raspatorien*

**Scollaperiostio**

*Periosteal elevators*

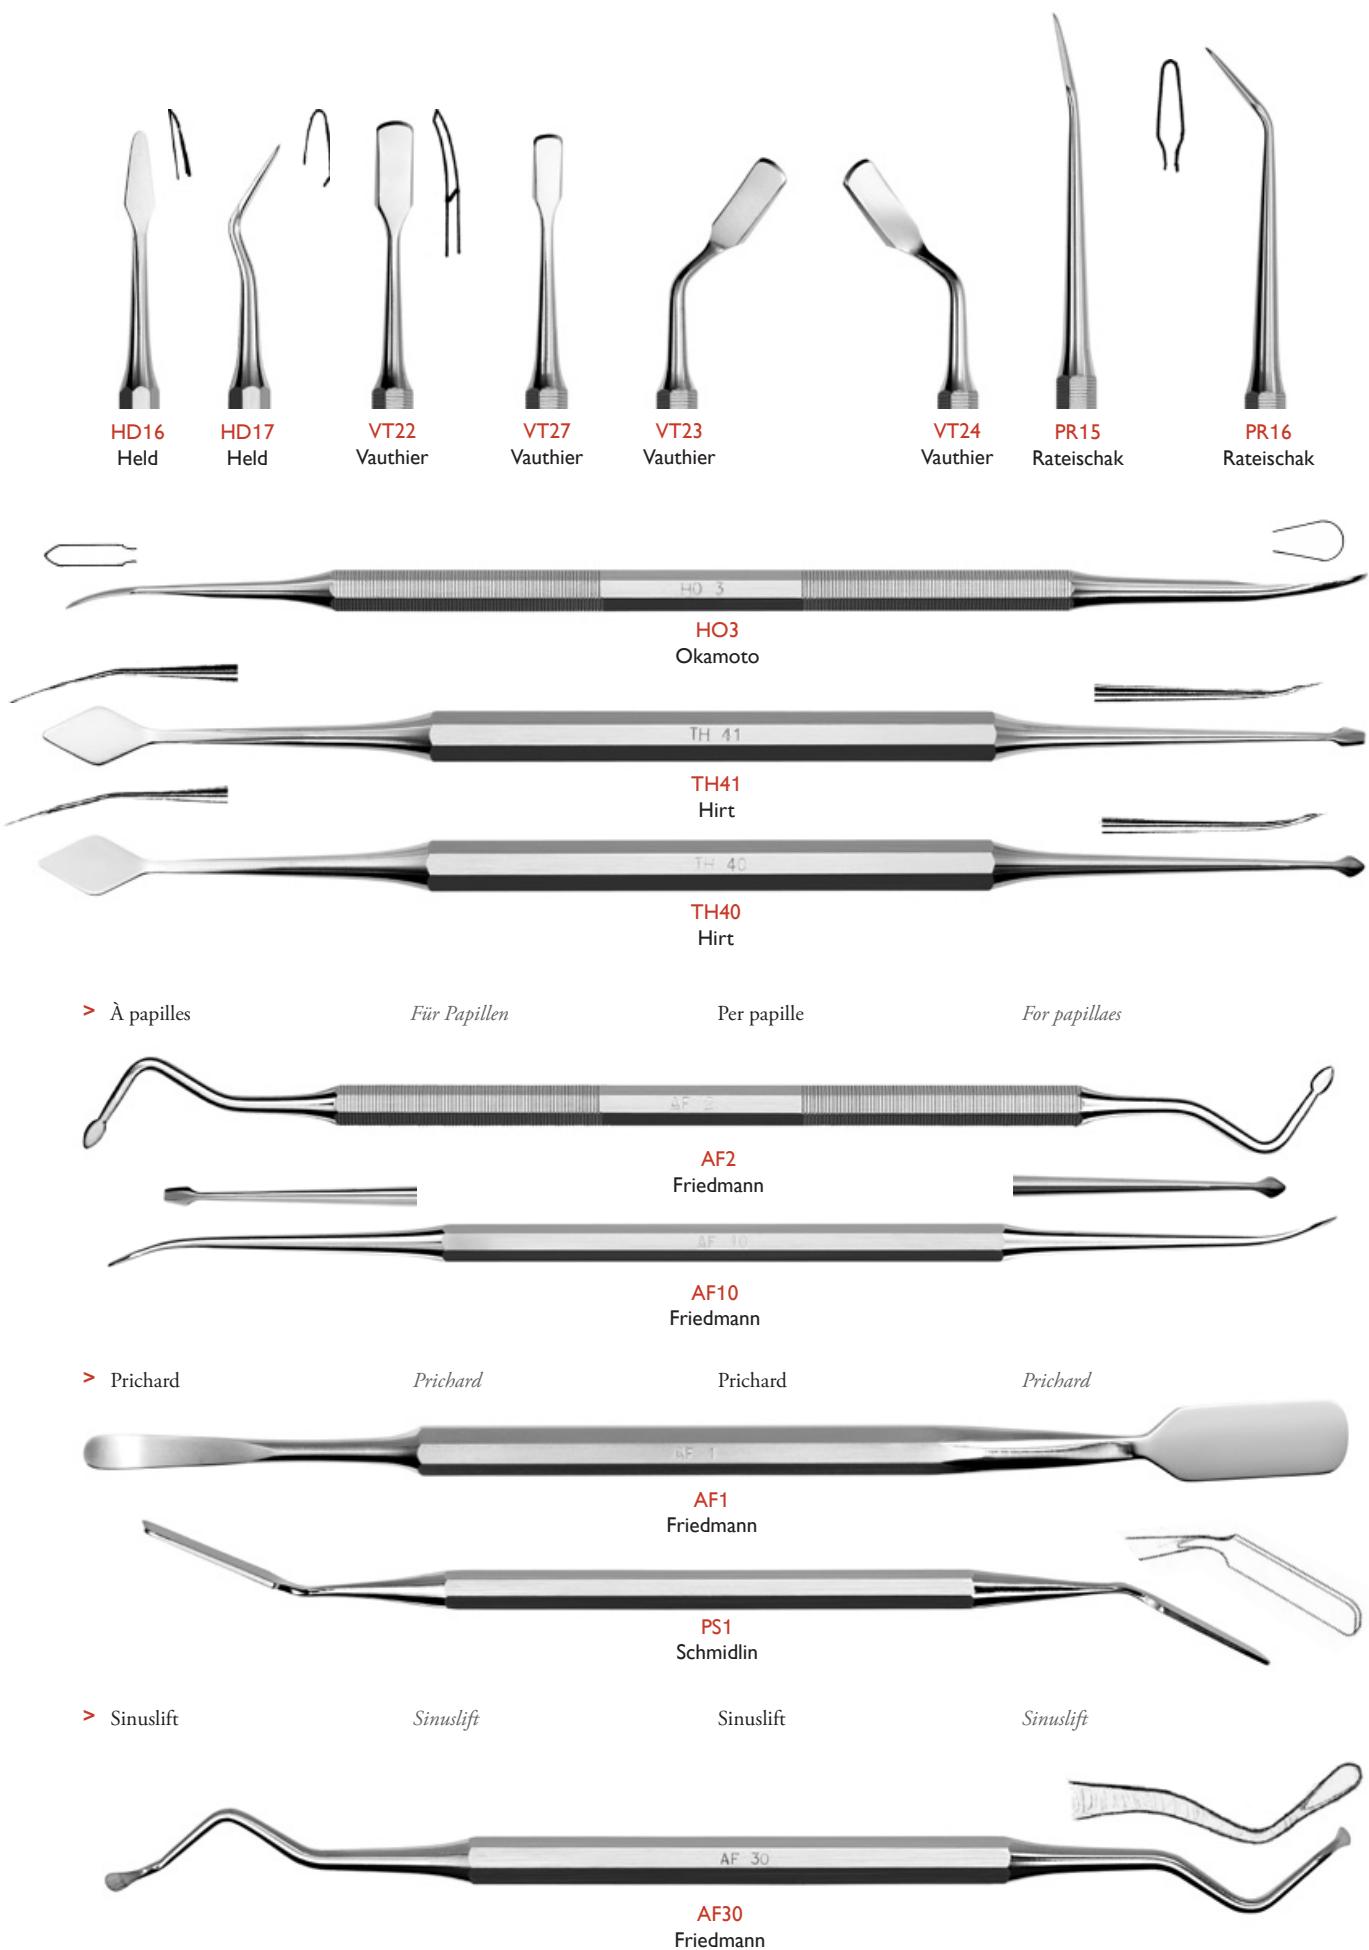

**Curettes chirurgicales**

*Chirurgische Küretten*

**Curette chirurgiche**

*Surgical curettes*



chirurgie

> Curettes alvéolaires

*Alveolarlöffel*

Cucchiai alveolari

*Spoon-shaped curettes*



## Curettes chirurgicales

## Chirurgische Küretten

## Curette chirurgiche

## Surgical curettes

### > Curettes fenêtrées

### Öhrloöffel

Ces curettes facilitent l'ablation des kystes.


### Cucchiai cavi

### Eyehole-spoons

Diese Küretten erleichtern die Entfernung von Zysten.

Curette per facilitare l'asportazione di cisti.

Remove cysts easily with these curettes.

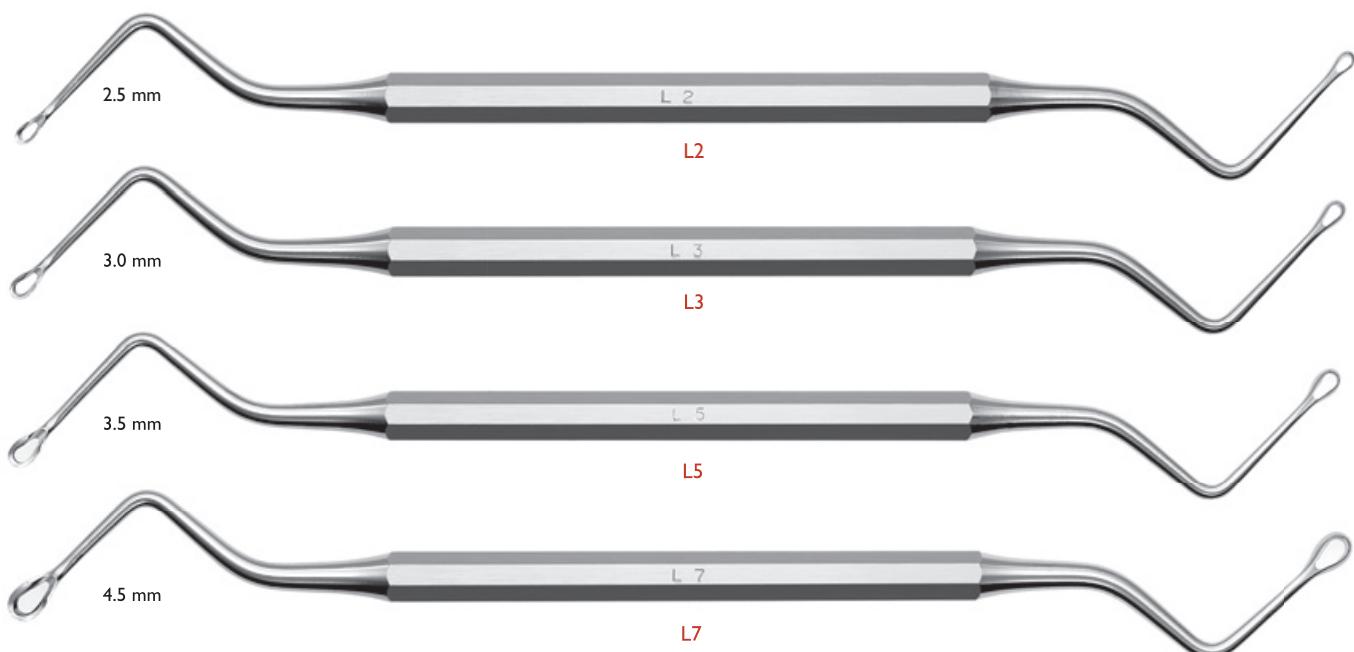


### > Curettes Planes

### Flache Löffel

### Cucchiai piani

### Flat spoons

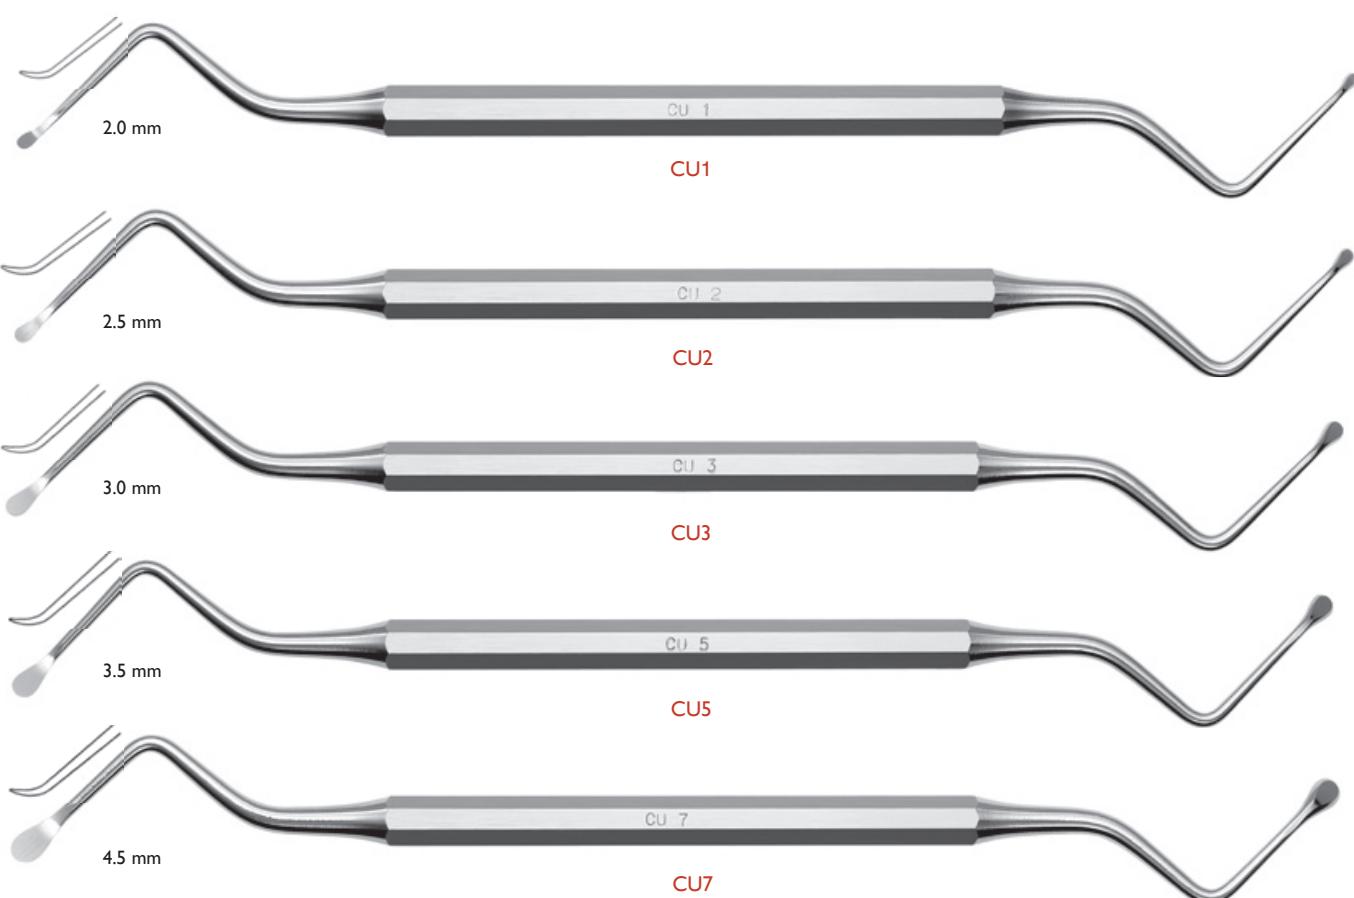


Limes à os

Knochenfeilen

Lime per osso

Bone files

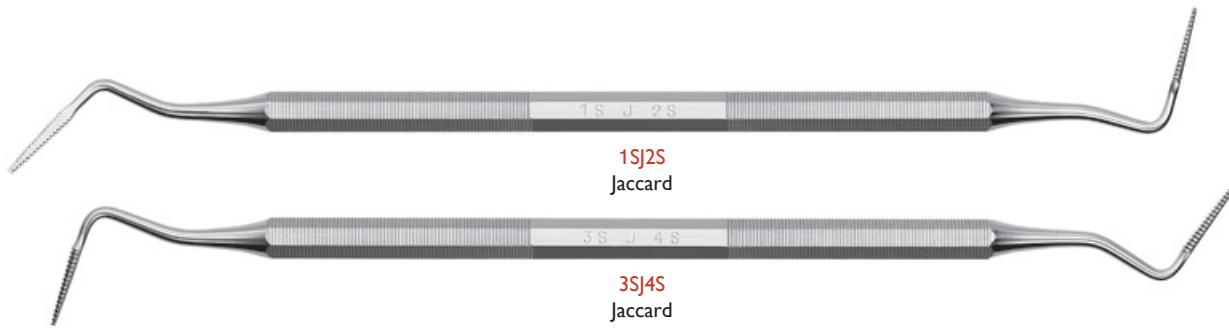


Ciseaux à os

Knochen Meissel

Scalpelli per osso

Bone chisels

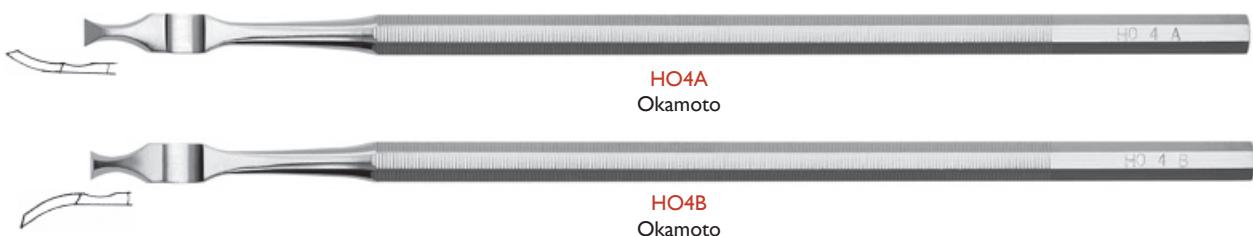

Râcleur à os

Knochenschaber

Raschietto per osso

Bone scraper



Couteaux et lancettes

Gingivektomie-Messer

Bisturi parodontali

Periodontal knives



## Couteaux pour micro-chirurgie

## *Micro-Chirurgie Messer*



>

pour travaux fins et préservation des papilles  
für eine feine Arbeit und gute Erhaltung der Papillen  
per lavori fini e preservazione delle papille  
for a fine work and safeguarding of the papillas



## Mucotomes pour le prélèvement des transplants

Les lames ont un seul côté tranchant et ne devraient être utilisées qu'une seule fois.  
(Jusqu'à épuisement du stock)

## *Mucotome für die Transplantat Entnahme*

Die Klingen haben nur eine Schnitt-Seite und dürfen nur einmal verwendet werden.  
(So lange Vorrat)

## *Mucotomi per il prelievo di trapianti*

Le lame hanno un solo lato tagliente e non dovrebbero essere utilizzate più di una volta.  
(Ad esaurimento)

## *Mucotomes for harvesting grafts*

Blades have a single cutting edge and should be used only once.  
(Until exhaustion)

## PROF. DR. K. H. RATEITSCHAK

### LPR

>

Livrés avec 10 lames  
Mit 10 Klingen geliefert  
Confezione da 10 lame  
Delivered with 10 blades

### PR1 & PR4




>

Droit  
Gerade  
Dritto  
Straight

### PR1A & PR4A

>

Coudé  
Geboden  
A Gomito  
Angled

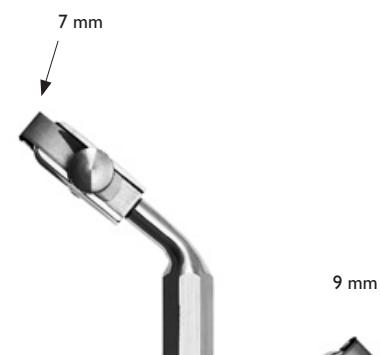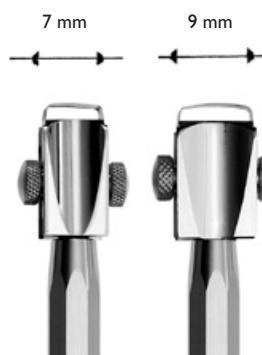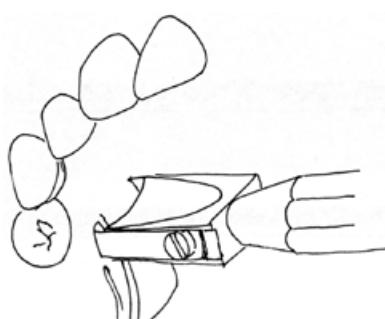

## Fouloir à mèche

## *Tamponstopfer*

## *Portatampone*

## *Gauze plugger*



## Élévateurs

## Wurzelheber

## Leve

## Elevators

### > Standards

Nos élévateurs sont fabriqués en acier inox trempé. Les manches, en acier inoxydable, sont ergonomiques, légers et assurent une prise ferme lors d'extractions.

**ATTENTION:** Utilisez toujours le modèle le plus robuste.

### Standard

Die DEPPELER™ Wurzelheber sind aus gehärtetem, rostfreiem Stahl hergestellt. Die ergonomischen Griffe aus rostfreiem Stahl sind leicht und liegen sicher und fest in der Hand.

**VORSICHT:** Wählen Sie immer den kräftigsten Wurzelheber.

### Standard

Le nostre leve sono fabbricate in acciaio inossidabile temperato. I manici, in acciaio inossidabile, sono ergonomici, leggeri ed assicurano una presa salda al momento dell'estrazione.

**ATTENZIONE:** Utilizzate sempre il modello più robusto.

### Standards

DEPPELER™ elevators are made of hardened stainless steel. The ergonomic handles, in stainless steel, are light and ensure a firm grip.

**CAUTION:** Always use the strongest elevator.



### > Lames dentelées

**ATTENTION:** Les élévateurs à lame dentelée sont plus fragiles que les autres.

### Gezackte Klingen

**VORSICHT:** Die gezackten Wurzelheber sind weniger widerstandsfähig als die glatten Modelle.

### Lame dentellate

**ATTENZIONE:** Le leve a lame dentate sono più fragili delle altre.

### Serrated blades

**CAUTION:** They are less resistant than smooth-bladed models.



**traitement conservateur**  
***zahnerhaltung***  
***conservativa***  
***restorative***

	<b>Composite</b>	<i>Composite</i>	<b>Composito</b>	<i>Composite</i>
31	> COMPro kit	> <i>COMPro Kit</i>	> COMPro kit	> <i>COMPro kit</i>
32	> Shadeline™	> <i>Shadeline™</i>	> Shadeline™	> <i>Shadeline™</i>
35	> Classic	> <i>Classic</i>	> Classic	> <i>Classic</i>
41	> Nitrule de titane	> <i>Titan Nitrid</i>	> Nitruro di titanio	> <i>Titanium nitrid</i>
44	<b>Autres instruments d'obturation</b>	<i>Andere Füllungs-Instrumente</i>	<b>Altri strumenti per l'otturazione</b>	<i>Other obturation instruments</i>
44	> Fouloirs lisses	> <i>Glatte Stopfer</i>	> Otturatori lisci	> <i>Smooth pluggers</i>
45	> Fouloirs striés	> <i>Gerillte Stopfer</i>	> Otturatori striati	> <i>Serrated pluggers</i>
45	<b>Élévateur à obturations provisoires</b>	<i>Hebel für provisorische Zahnfüllungen</i>	<b>Leva per otturazioni provvisorie</b>	<i>Elevator for temporary fillings</i>
45	<b>Détection de fissures</b>	<i>Fissuren Detektion</i>	<b>Sondaggio di fessure</b>	<i>Fissures detection</i>
46	<b>Ciseaux</b>	<i>Schmelzmesser</i>	<b>Tagliasmalto</b>	<i>Chisels</i>
46	> Ciseaux à émail	> <i>Schmelzmesser</i>	> Tagliasmalto	> <i>Chisels</i>
47	> Ciseaux pour bords gingivaux	> <i>Randfinierer</i>	> Scalpelli per margini	> <i>Margin trimmers</i>
48	> Ciseaux à pointes diamantées	> <i>Diamantierte Randfinierer</i>	> Scalpello per margini diamantato	> <i>Diamond coated margin trimmers</i>
49	<b>Excavateurs</b>	<i>Excavatoren</i>	<b>Escavatori</b>	<i>Excavators</i>
49	> Goutte d'eau	> <i>Wassertropfen</i>	> Goccia d'acqua	> <i>Water drop</i>
50	> Cylindriques	> <i>Zylindrisch</i>	> Cilindrici	> <i>Cylindric</i>
50	<b>Spatules à ciment</b>	<i>Zement Spatel</i>	<b>Spatole per cemento</b>	<i>Cement spatulas</i>
51	<b>Endodontie</b>	<i>Endodontie</i>	<b>Endodontia</b>	<i>Endodontic</i>
51	> Sondes à canaux	> <i>Kanalsonden</i>	> Sonde endodontiche	> <i>Root canal explorers</i>
51	> Micro-miroirs	> <i>Micro-Spiegel</i>	> Micro-specchietti	> <i>Micro-mirrors</i>
52	> Fouloirs à canaux condenseur	> <i>Wurzelkanal-Stopfer Kondensatoren</i>	> Otturatori-condensatori	> <i>Root canal condensers</i>
53	> Fouloirs pour la condensation verticale	> <i>Stopfer für die vertikale Kondensation</i>	> Compattatori per la condensazione verticale	> <i>Pluggers for vertical condensation</i>
53	<b>Fouloirs pour fil de retraction gingivale</b>	<i>Retraktionsfaden-Stopfer</i>	<b>Strumenti per cordino retrattore gengivale</b>	<i>Gingival cord layers</i>
54	> Résection apicale	> <i>Wurzelspitzen Resektion</i>	> Apicectomia	> <i>Apicectomy</i>

**Composite****Composite****Composito****Composite**

## &gt; COMPro kit

Le kit professionnel pour les traitements conservateurs

## COMPro Kit

Ein Professionelles Kit für die Zahnerhaltung.

## COMPro kit

Un kit professionale per il trattamento conservativo.

## COMPro kit

One professional kit for the conservative treatment.



CPR01 // CPR01CT



CPR02 // CPR02CT

Grâce à sa forme plate et bombée, le fouloir ne s'engouffre pas, et ne marque pas le composite avec ses bords.

Die überdachte Form des Stopfers, flach in der Mitte und gewölbte Kanten vermeiden einerseits das Absinken in den Composite und andererseits die Rillen im Composite mit den Kanten des Stopfers.

L'estremità leggermente semisferica, anziché completamente bombata, evita lo sprofondamento dello strumento garantendo un migliore adattamento del composito alle pareti delle cavità.

The rounded-flat shape prevents the plugger from sinking into the composite and do not mark with its edges.




CPR03 // CPR03CT

Instrument à modeler: Les extrémités très fines et pointues permettent de reconstituer la dent dans les moindres détails anatomiques.

Instrument für die okklusale Modellierung. Die scharfen Enden gewährleisten eine sehr glatte und exakte Modellierung auch für die kleinsten anatomischen Details.

Strumento per la modellazione oclusale. Le estremità molto acuminate garantiscono una modellazione fluida e precisa anche dei più piccoli dettagli anatomici.

Modelling instrument. The very pointy tips allow a precise reconstruction of the teeth until the finest anatomical details.

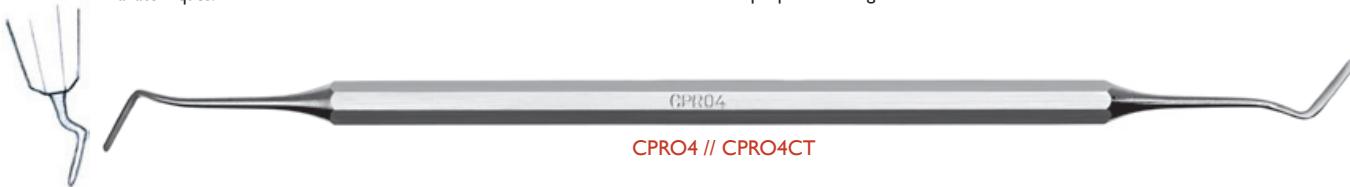

CPR04 // CPR04CT

Double spatule fine, flexible et tranchante. La flexibilité permet à la spatule de s'adapter à la surface de la dent. Les bords extrêmement fins et tranchants permettent aussi de l'utiliser comme carver.

Feiner, flexibler und scharfer doppelseitiger Spatel. Die Flexibilität erlaubt es dem Spatel sich vollständig am Zahn anzupassen. Die extrem feinen und scharfen Kanten erlauben es sogar, das Instrument als echter Schnitzer zu verwenden.

Doppia spatola interprossimale, fine, flessibile e tagliente. La flessibilità le permette di adattarsi alla superficie del dente. I bordi estremamente fini e taglienti permettono di utilizzarla anche come carver.

Fine, flexible and sharp double spatula. Thanks to its high flexibility the spatula adapts to the teeth. The extremely fine and sharp edges allow to use the instrument as a carver.

Attention: Essuyer rapidement la pointe après l'application du composite afin d'enlever le film qui peut adhérer. Ne pas nettoyer avec une brosse agressive. Les microsillons rendent la surface de l'instrument adhérente au composite.

Achtung: Nach Gebrauch von Composite-Materialien reinigen Sie bitte die Spitze sofort, um alle Rückstände, die anhafteten können, zu entfernen. Bitte keine aggressive Stahl-Bürste verwenden.

Attenzione : pulire rapidamente dopo l'uso in modo da rimuovere la pellicola che potrebbe aderire. Non pulire con uno spazzolino aggressivo : i microsolchi rendono la superficie dello strumento aderente al composito.

Caution: Clean the tip immediately after applying composite to remove possible film. Do not clean with a hard bristle brush. Fine scratches make it easy for composite to adhere to the surface.



CPR0 // CPR0CT

## &gt;

Classic ou Nitrure de titane (CT)  
Classic oder Titan Nitrid (CT)  
Classic o Nitruro di Titanio (CT)  
Classic or Titanium Nitride (CT)

## Composite

### > Shadeline™

X-Shadeline™: Cette nouvelle gamme d'instruments bénéficie d'un revêtement à la pointe de la technologie. Son coefficient de frottement et sa résistance à l'abrasion sont optimum. De plus, leur couleur noire évite au praticien d'être gêné par les reflets de l'acier. Les instruments Shadeline™ permettent une manipulation et un modelage plus fluide des différents matériaux composite.

Attention: Essuyer rapidement la pointe après l'application du composite afin d'enlever le film qui peut adhérer. Ne pas nettoyer avec une brosse agressive. Les microsillons rendent la surface de l'instrument adhérente au composite.

### - Spatules

Epaisseur de lame : 0.22 mm



1.6 mm



1.5 mm



1.0 mm



1.6 mm



1.5 mm



1.6 mm



1.8 mm



1.5 mm



2.6 mm

## Composite

### Shadeline™

X-Shadeline™: Diese neue Reihe von Instrumenten hat den neuesten, hoch technischen Belag. Er hat einen optimalen Abreibungs-Co-Effizienten und ist verschleißfest. Ausserdem dient die Ausführung in Schwarz dazu, dass der Verwender durch die Stahl-Reflektion nicht irritiert werden kann. Die Shadeline™ Instrumente ermöglichen ein besseres Handhaben und Modellieren der verschiedenen Composite-Materialien.

Achtung: Nach Gebrauch von Composite Materialien reinigen Sie bitte die Spitze sofort, um alle Rückstände, die anhaften können, zu entfernen. Bitte keine aggressive Bürste verwenden.

### - Spatel

Klingen Stärke : 0.22 mm

## Composito

### Shadeline™

X-Shadeline™: Questa nuova gamma di strumenti beneficia di un rivestimento tecnologicamente all'avanguardia. Il suo coefficiente di sfregamento e la sua resistenza all'abrasione è ottimale. Inoltre, il loro colore nero evita al medico di essere disturbato dai riflessi dell'acciaio. Gli strumenti Shadeline™ permettono una manipolazione ed una modellazione più fluida dei diversi materiali compositi.

Attenzione : Pulire rapidamente dopo l'uso in modo da rimuovere la pellicola che potrebbe aderire. Non pulire con uno spazzolino aggressivo: i microsolchi rendono la superficie dello strumento aderente al composito.

### - Spatole

Spessore delle lame : 0.22 mm

## Composite

### Shadeline™

X-Shadeline™: This new instrument range has the very latest high technical coating. It has optimal friction coefficient and resistance to abrasion. Furthermore, the black finish means the user is not irritated by reflections from steel. The Shadeline™ instruments make for easier handling and more fluid shaping of composite materials.

Caution: Clean the tip immediately after applying composite to remove possible film. Do not clean with a hard bristle brush. Fine scratches make it easy for composite to adhere to the surface.


### - Spatulas

Blade thickness : 0.22 mm



**Composite**

- > Shadeline™
- Spatules

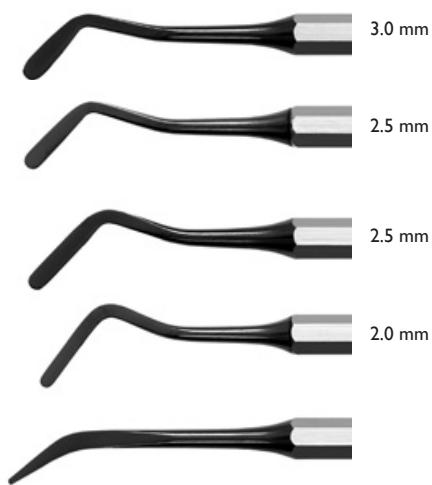**Composite**

- Shadeline™*
- Spatel*

**Composito**

- Shadeline™*
- Spatole*

OP22X

ZI62X


OP6X  
HeidemannOP54X  
Heidemann

OP58X

2.6 mm

**Composite**

- Shadeline™*
- Spatulas*

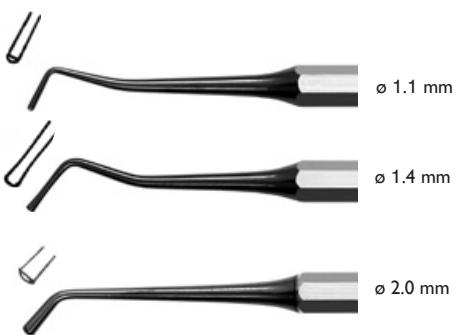**Spatules-Fouloirs****Spatel-Stopfer****Spatole-Otturatori****Spatulas-Pluggers**

OP3X


OP661X

OP2X

1.8 mm

2.0 mm

3.0 mm

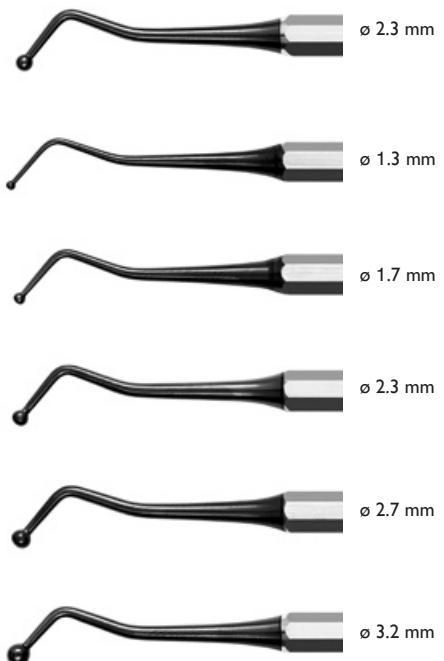**Fouloir boules****Kugelstopfer****Brunitoi****Ball pluggers**MB6X  
Besek

127X

126X

125X

124X

123X

ø 0.6 mm

ø 1.0 mm

ø 1.3 mm

ø 1.7 mm

ø 2.3 mm

ø 2.7 mm



## **Composite**

> Shadeline™

- Fouloirs



- Instruments à modeler

## **Composite**

Shadeline™

- Stopfer

ø 1.8 mm

ø 2.2 mm

ø 1.6 mm

ø 1.8 mm

ø 1.2 mm

- Modellier-Instrumente

## **Composito**

Shadeline™

- Otturatori

**MB1X**

Besek

**MB2X**

Besek

**OP80X**

**OP46X**

**OP46DX**

**OP80PX**

**OP36MPX**

- Strumenti da modellazione

## **Composite**


Shadeline™

- Pluggers



- Modelling instruments

traitement conservateur

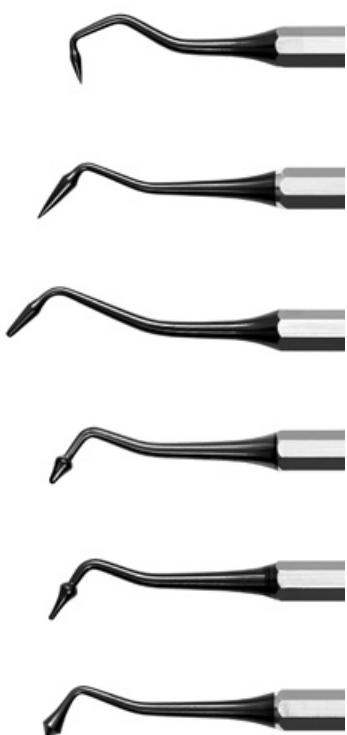

**MB3X**  
Besek


**HZ3X**

**MF2X**

**TH28X**  
Hirt

**HZ25X**

**CK28BX**

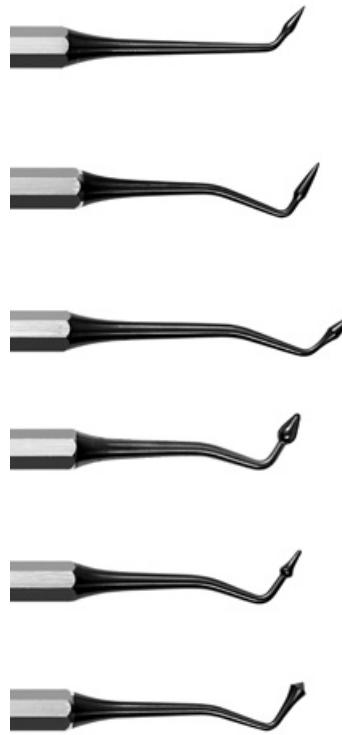

**Composite**

## &gt; Classic

C-Classic: La qualité de notre acier et nos méthodes de fabrication assurent un coefficient d'adhérence inférieur à la moyenne.

Attention: Essuyer rapidement la pointe après l'application du composite afin d'enlever le film qui peut adhérer. Ne pas nettoyer avec une brosse agressive. Les microsillons rendent la surface de l'instrument adhérente au composite.

**Spatules**

Epaisseur de lame 0.22 mm

**Composite***Classic*

C-Classic: Stahlqualität und Herstellungsmethoden bedeuten, dass ihr Haftvermögen-Co-Effizient niedriger als der Durchschnitt ist.

Achtung: Nach Gebrauch von Composite Materialien reinigen Sie bitte die Spitze sofort, um alle Rückstände, die anhaften können, zu entfernen. Bitte keine aggressive Bürste verwenden.

**Spatel**

Klingen-Stärke 0.22 mm

**Composito***Classic*

C-Classic: La qualità del nostro acciaio ed i nostri metodi di fabbricazione assicurano un coefficiente di aderenza inferiore alla media.

Attenzione : Pulire rapidamente dopo l'uso in modo da rimuovere la pellicola che potrebbe aderire. Non pulire con uno spazzolino aggressivo : i microsolchi rendono la superficie dello strumento aderente al composito.

**Spatole**

Spessore delle lame 0.22 mm

**Composite***Classic*

C-Classic: Steel quality and manufacturing methods mean that adhesion coefficient is lower than average.

Caution: Clean the tip immediately after applying composite to remove possible film. Do not clean with a hard bristle brush. Fine scratches make it easy for composite to adhere to the surface.

**Spatulas**

Blade thickness 0.22 mm



1.6 mm

**MB4C**  
Besek

>  
approximal



1.5 mm

**MB5C**  
Besek

>  
bombé et tranchant  
gewölbt und scharf  
bombato e tagliente  
rounded and sharp



1.0 mm

**OP551C**



1.6 mm

**OP55C**



1.5 mm

**ZI66C**



1.6 mm

**OP33DC**



1.8 mm

**OP3DC**



1.5 mm

**TH66C**  
Hirt

>  
bombé et tranchant  
gewölbt und scharf  
bombato e tagliente  
rounded and sharp



2.6 mm

**OP26C**



3.0 mm

**OP22C**



2.5 mm

**ZI62C**



**Composite**

> Classic  
- Spatules



2.5 mm



2.0 mm



2.4 mm



2.3 mm



2.0 mm

**Spatules-Fouloirs**

ø 1.1 mm



ø 1.4 mm



ø 2.0 mm



ø 0.9 mm



ø 1.0 mm



ø 1.0 mm



ø 1.0 mm



ø 0.9 mm

ø 0.9 mm

**Composite**

*Classic*  
*Spatel*



2.5 mm



2.0 mm



2.4 mm



2.3 mm



2.0 mm

**Spatel-Stopfer**

ø 1.1 mm



ø 1.4 mm



ø 2.0 mm



ø 0.9 mm



ø 1.0 mm



ø 1.0 mm



ø 1.0 mm



ø 0.9 mm

ø 0.9 mm

**Composito**

*Classic*  
*Spatole*

**OP6C**  
Heidemann

**OP54C**  
Heidemann

**OP58C**

**OP84**  
Heidemann

**OP40**  
Heidemann

**OP4**

**Composite**

*Classic*  
*Spatulas*

**OP6C**  
Heidemann

**OP54C**  
Heidemann

**OP58C**

**OP84**  
Heidemann

**OP40**  
Heidemann

**OP4**

**Spatole-Otturator**

**OP3C**

**OP661C**

**OP2C**

**OP33C**

**ZI63C**

**OP30C**

**OP31C**

**OP300C**

**OP311C**

**Spatulas-Pluggers**

**1.8 mm**

**2.0 mm**

**3.0 mm**

**1.6 mm**

**2.0 mm**

**1.6 mm**




**1.6 mm**

**1.6 mm**

**1.6 mm**

**Composite**

&gt; Classic

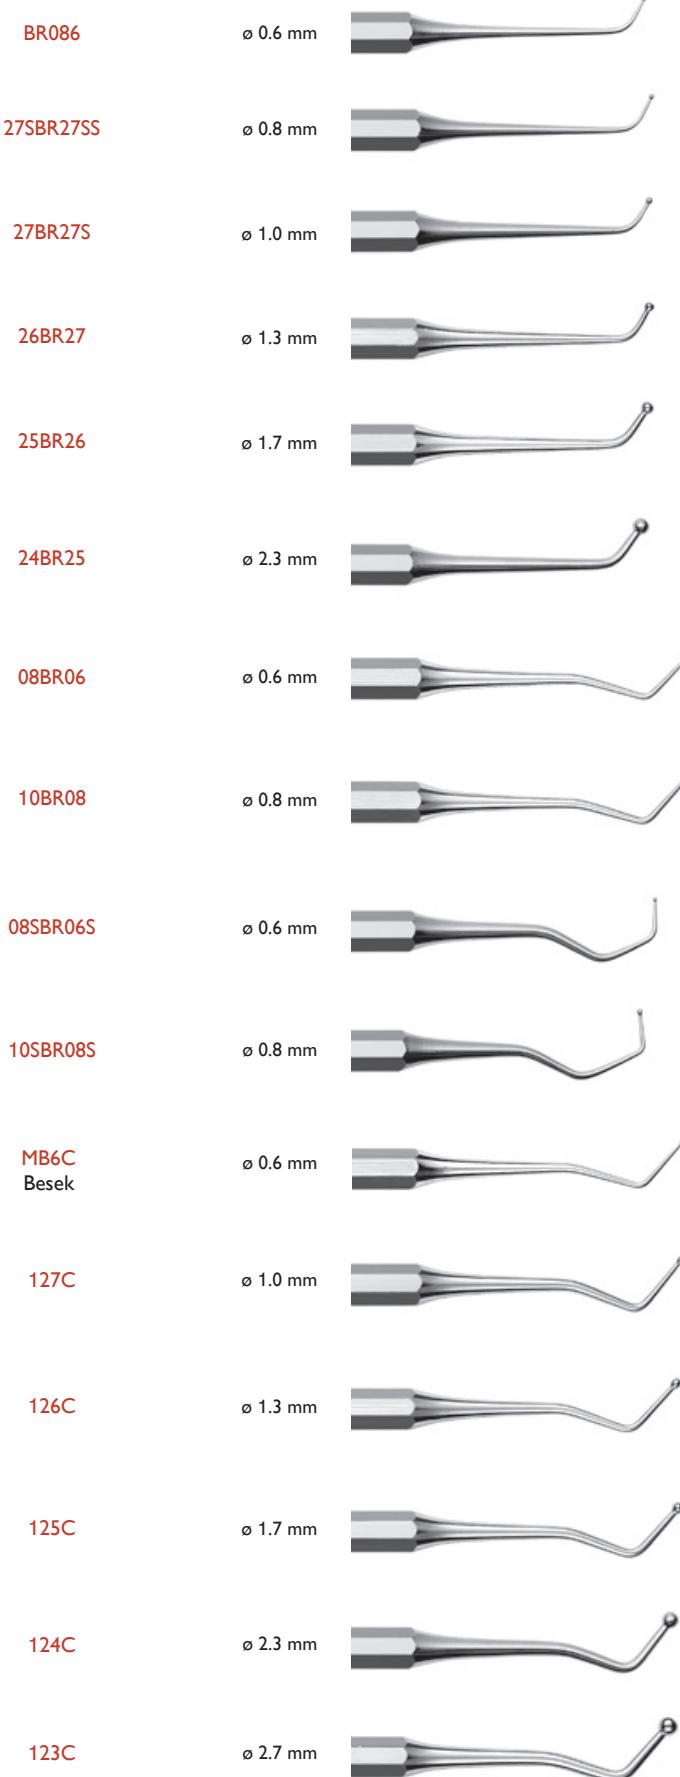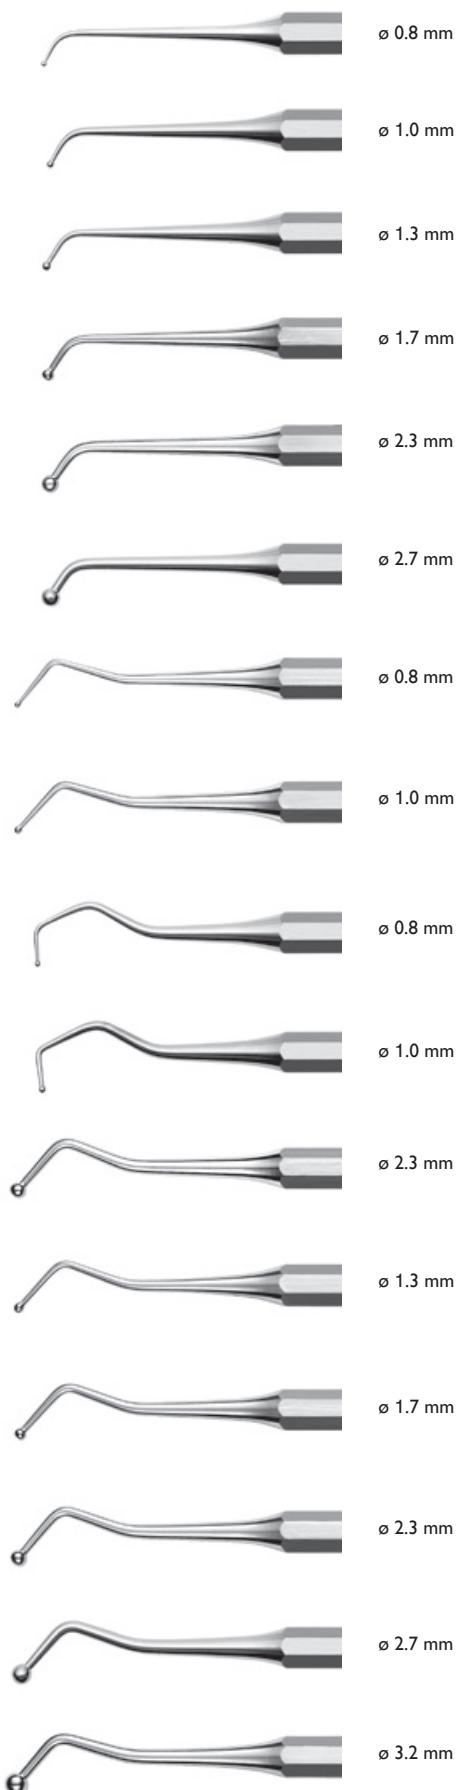Fouloirs boules**Composite**- *Classic*Kugelstopfer**Composito**- *Classic*Brunitoi**Composite**- *Classic*Ball pluggers

## Composite

> Classic  
Fouloirs



Classic  
Stopfer



ø 1.8 mm



ø 2.2 mm



ø 1.6 mm



ø 1.8 mm



ø 1.2 mm

## Composite

Classic  
Stopfer

## Composito

Classic  
Otturatori

MB1C  
Besek

Classic  
Pluggers



MB2C  
Besek



OP80C

ø 1.1 mm



OP46C

ø 1.6 mm



OP46DC

ø 1.1 mm



OP80PC

ø 1.1 mm



OP36MPC

ø 0.9 mm



“Die Präzision  
der Fertigung, die  
Haltbarkeit und das  
Handling sind bei diesen  
Handinstrumenten auch  
im Vergleich zu anderen  
Systemen absolut  
unübertroffen.”

Prof. Dr. Michael Haas

## Composite

- > Classic
- Instruments à modeler



## Composite

- Classic
- Modellier-Instrumente

## Composito

- Classic
- Strumenti da modellazione

CK28BC

TH28C  
Hirt

HZ25C

MB3C  
Besek

HZ3C

MF2C

CK10

OP37

PJ4

28BR29

## Composite

- Classic
- Modelling instruments



**“I couldn’t do my job properly without your instruments!”**

*Prof. Rateitschak*

## Composite

> Classic  
- Carvers



## Composite

Classic  
- Schnitzer



## Composito

Classic  
- Carver



## Composite

Classic  
- Carvers



VD8  
>  
Interproximal  
Approximal  
Interprossimale  
Approximal

HZ8, HZ9  
>  
Box carver pour éliminer les surplus  
Box Carver um die Überschüsse zu entfernen  
Box carver per eliminare gli eccessi  
Box carver to remove the excess

**Composite**

## &gt; Nitre de titane

CT-Nitre de titane: La géométrie des instruments est absolument identique aux pièces classiques, mais ils présentent un revêtement de nitre de titane. Ce traitement de surface a des qualités éprouvées de non-adhérence.

Attention: Essuyer rapidement la pointe après l'application du composite afin d'enlever le film qui peut adhérer. Ne pas nettoyer avec une brosse agressive. Les microsillons rendent la surface de l'instrument adhérente au composite.

**Composite***Titan Nitrid*

*CT-Titan Nitrid:* Die Instrumentenform ist mit denen der Classic Model- len identisch, aber mit einer Titan Nitrid-Beschichtung ausgestattet. Diese Oberflächen-Behandlung hat die nichthaftenden Eigenschaften.

Achtung: Nach Gebrauch von Com posite Materialien reinigen Sie bitte die Spitze sofort, um alle Rückstände, die anhaften können, zu entfernen. Bitte keine aggressiven Bürste verwenden.

**Composito**

## Nitruro di titanio

*CT-Nitruro di titanio:* La geometria degli strumenti è identica a quella classica ma il rivestimento è in titanio. Questo trattamento di superficie ha qualità provate di non aderenza.

Attenzione : Pulire rapidamente dopo l'uso in modo da rimuovere la pellicola che potrebbe aderire. Non pulire con uno spazzolino aggressivo : i microsolchi rendono la superficie dello strumento aderente al composito.

**Composite***Titan nitrid*

*CT-Titanium Nitrid:* The instrument shape is identical to that of the Classic models but with a titanium nitrid coating. This surface treatment has proven non-stick properties.

Caution: Clean the tip immediately after applying composite to remove possible film. Do not clean with a hard bristle brush. Fine scratches make it easy for composite to adhere to the surface.

**Spatules***Spatel*

Epaisseur de lame 0.22 mm

Klingen-Stärke 0.22 mm

**Spatole***Spatulas*

Blade thickness 0.22 mm



1.6 mm

**MB4CT**  
Besek

&gt; approximal



1.5 mm

**MB5CT**  
Besek
> bombé et tranchant  
gewölbt und scharf  
bombato e tagliente  
rounded and sharp

1.0 mm

**OP551CT**

1.6 mm

**OP55CT**

1.5 mm

**ZI66CT**

1.6 mm

**OP33DCT**

1.8 mm

**OP3DCT**

1.5 mm

**TH66CT**  
Hirt
>  
bombé et tranchant  
gewölbt und scharf  
bombato e tagliente  
rounded and sharp

2.6 mm

**OP26CT**

3.0 mm

**OP22CT**

## Composite

> Nitre de titane  
Spatules



2.5 mm



2.5 mm



2.0 mm



Spatules-Fouloirs

Spatel-Stopfer



Ø 1.1 mm



Ø 1.4 mm



Ø 2.0 mm

## Composite

Nitruro di titanio  
Spatole

ZI62CT

Titan nitrid  
Spatulas



OP6CT  
Heidemann



OP54CT  
Heidemann



OP58CT

2.6 mm



Spatules-pluggers

Spatole-otturatori

OP3CT

1.8 mm



OP661CT

2.0 mm



OP2CT

3.0 mm



Fouloirs boules

Kugelstopfer

Brunitoi

Ball pluggers



Ø 2.3 mm

MB6CT  
Besek

Ø 0.6 mm



Ø 1.3 mm

127CT

Ø 1.0 mm



Ø 1.7 mm

126CT

Ø 1.3 mm



Ø 2.3 mm

125CT

Ø 1.7 mm



Ø 2.7 mm

124CT

Ø 2.3 mm



Ø 3.2 mm

123CT

Ø 2.7 mm



## Composite

- > Nitre de titane
- Fouloirs



**MB1CT**  
Besek



**MB2CT**  
Besek



ø 1.8 mm

**OP80CT**



ø 2.2 mm

**OP46CT**



ø 1.6 mm

**OP46DCT**



ø 1.8 mm

**OP80PCT**



ø 1.2 mm

**OP36MPCT**

## Titan nitrid

- Pluggers



ø 1.1 mm



ø 1.6 mm



ø 1.1 mm



ø 1.1 mm



ø 0.9 mm

## Instruments à modeler

## Modellier-Instrumente

## Strumenti da modellazione

## Modelling instruments



**MB3CT**  
Besek



**HZ3CT**



**MF2CT**



**TH28CT**  
Hirt



**HZ25CT**



**CK28BCT**



**Autres instruments  
d'obturation**

> Fouloirs lisses

**Andere Füllungs-  
Instrumente**


*Glatte Stopfer*

**Altri strumenti per  
l'otturazione**

Otturatori lisci

**Other obturation  
instruments**

*Smooth pluggers*

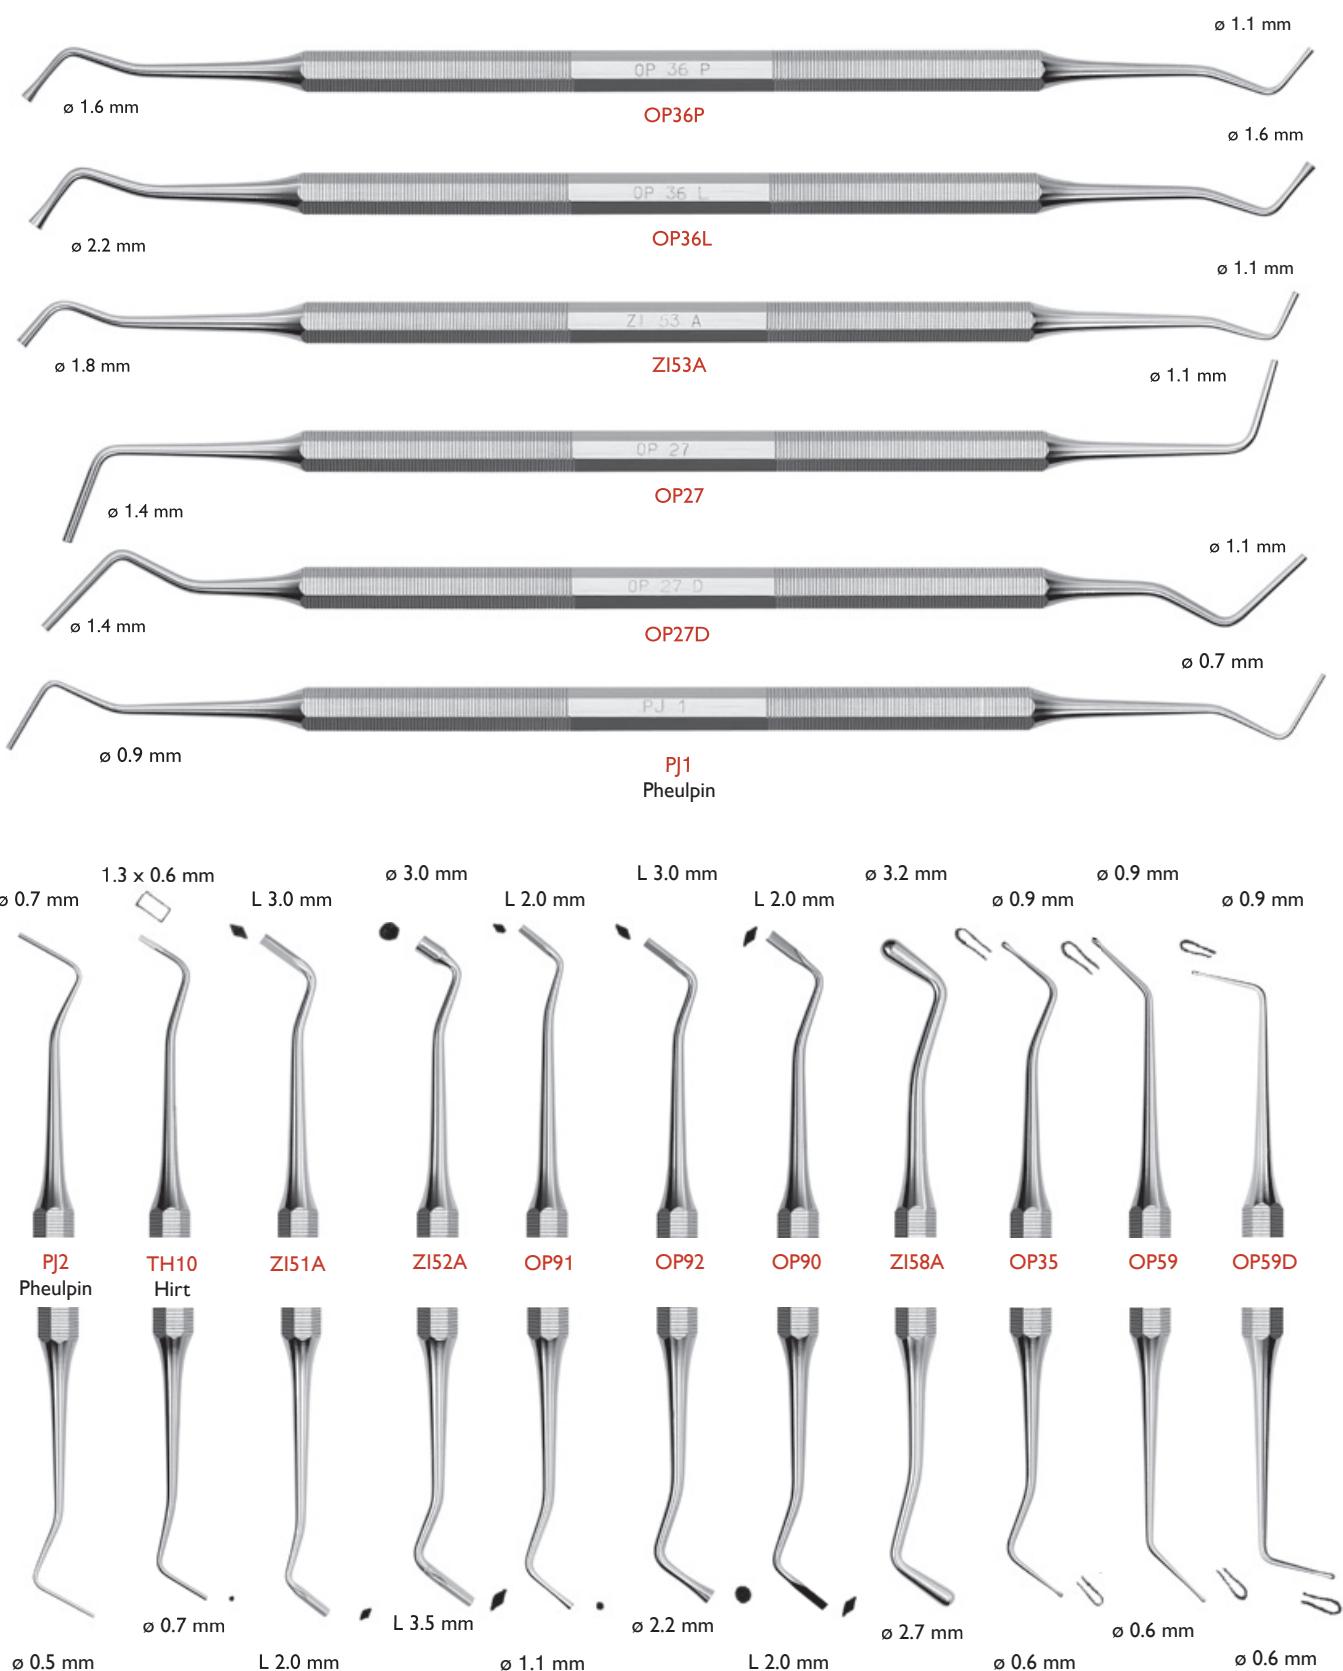

**OP90**

>

angulation gauche, droite  
Angulierung links, rechts  
angolazione sinistra, destra  
angulation left, right

**Autres instruments d'obturation**

&gt; Fouloirs striés

**Andere Füllungs-Instrumente***Gerillte Stopfer***Altri strumenti per l'otturazione****Other obturation instruments** $\varnothing 1.2 \text{ mm}$  $\varnothing 1.3 \text{ mm}$  $\varnothing 1.6 \text{ mm}$  $\varnothing 2.2 \text{ mm}$  $\varnothing 2.0 \text{ mm}$  $\varnothing 1.7 \text{ mm}$  $\varnothing 2.6 \text{ mm}$  $\varnothing 2.2 \text{ mm}$  $\varnothing 2.6 \text{ mm}$  $\varnothing 3.6 \text{ mm}$ 

OP36M



OP43



OP36D

OP7DS



OP52



ZI51



OP44

1BR2



2BR3

 $\varnothing 0.9 \text{ mm}$  $\varnothing 1.0 \text{ mm}$  $\varnothing 1.1 \text{ mm}$  $\varnothing 1.6 \text{ mm}$  $\varnothing 1.2 \text{ mm}$  $\varnothing 2.2 \text{ mm}$  $\varnothing 1.7 \text{ mm}$  $\varnothing 2.6 \text{ mm}$ **Élévateur à obturations provisoires**

N'abimez pas vos scalers, utilisez l'instrument approprié

**Hebel für provisorische Zahnfüllungen**

Beschädigen Sie Ihre Scaler nicht, wählen Sie das zweckmässige Instrument

**Leva per otturazioni provvisorie**

Non rovinate i vostri scalers, utilizzate lo strumento appropriato

**Elevator for temporary fillings**

Don't damage your scalers, use the proper instrument



SE8

**Détection de fissures**

Sondes extrêmement fines, diamètre 0.15 mm et 0.25 mm pour la détection de fissures dans les scellements composite.

**Fissuren Detektion**

Extrem feine Sonden, Durchmesser 0.15 mm und 0.25 mm für die Abtastung von Fissuren in der Versiegelung des Composites.

**Sondaggio di fessure**

Sonde estremamente fini di diametro di 0.15 mm e 0.25 mm per il sondaggio di fessure nel sigillo del composito.

**Fissures detection**

Extremely fine explorers, diameter 0.15 mm and 0.25 mm for the detection of fissures in the sealing of the composite.



150EX

250EX

**MATRIX**>  
0.025 mm  
0.050 mm  
0.100 mm**150/250EX KIT**>  
2x 150EX & 250EX + 3x matrix

**Ciseaux**

- > Ciseaux à émail
- Wedelstaedt



1.5 mm

**Schmelzmesser**

- Schmelzmesser*
- Wedelstaedt

**Tagliasmalto**

- Tagliasmalto
- Wedelstaedt

**Chisels**

- Chisels*
- Wedelstaedt

41CI42

43CI44

BlackBlackBlackBlack

Houe

Haue

Zappetta

Hoe



Ciseau hachette

Schmelzbeil

Tagliasmalto-accetta

Enamel Hatchet

Ciseau contre-coudé

Gegenwinklige Schmelzmesser

Tagliasmalto controcureve

Counter-bent chisel

1.0 mm

83CI83D

Ciseaux droits

Gerade Schmelzmesser

Tagliasmalto dritti

Straight chisels

1.5 mm

CI85

2.0 mm

CI84

3.0 mm

CI3

Elmar ReichElmar ReichElmar ReichElmar Reich


1.25 mm

3ER4



**Ciseaux**

- > Ciseaux pour bords gingivaux
- Massironi



1.7 mm

Black

1.0 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.5 mm

Woodbury**Schmelzmesser**

- Randfinierer
- Massironi

Black


- >
- 177CI178
- 277CI278
- 77CI78
- Left+right

**Tagliasmalto**

- Scalpelli per margini
- Massironi

Black

- >
- 179CI180
- 279CI280
- 79CI80
- Left+right

**Chisels**

- Margin trimmers
- Massironi

Black

- >
- 179CI180
- 279CI280
- 79CI80
- Left+right



32 CI 33

34 CI 35

CuillèresLöffelWoodburySpoons

62 NS 61

37 NS 36

66 NS 65

66NS65

**Ciseaux**

- > Ciseaux pour bords gingivaux
- Raoul Boitel

**Schmelzmesser**


- Randfinierer*
- Raoul Boitel*

**Tagliasmalto**

- Scalpelli per margini
- Raoul Boitel

**Chisels**

- Margin Trimmer*
- Raoul Boitel*

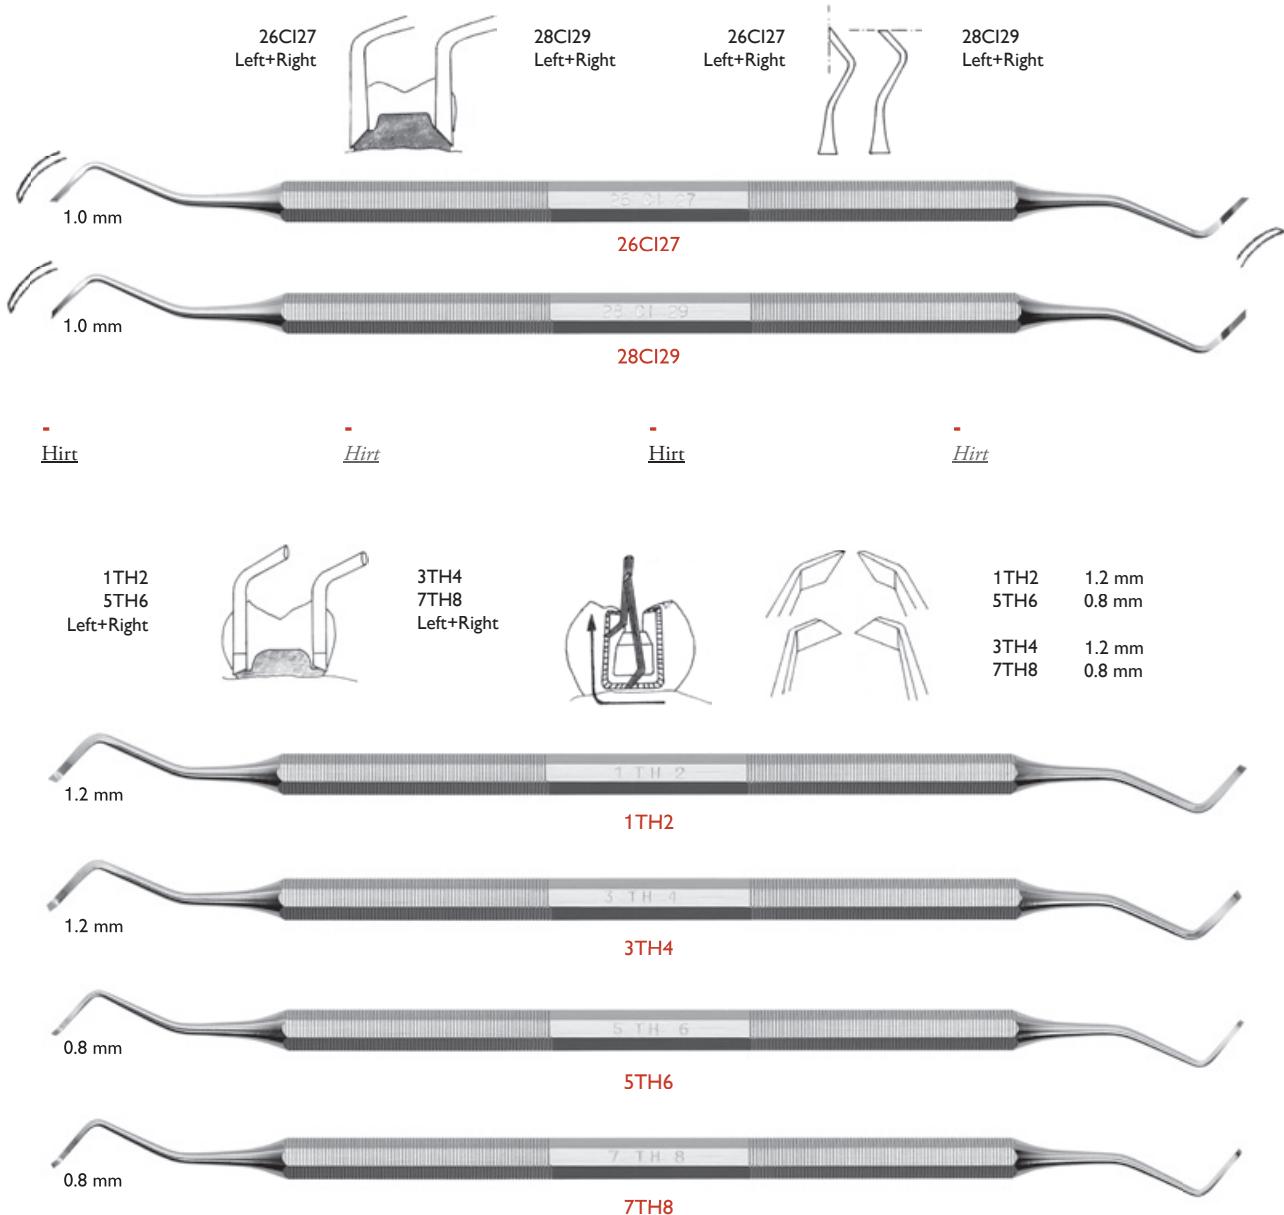


- > Ciseaux à pointes diamantées

*Diamantierte Randfinierer*

- Scalpello per margini diamantato

- Diamond coated margin trimmers*

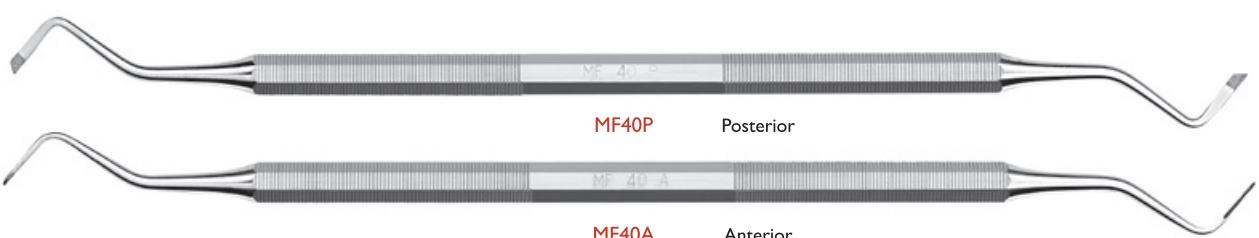

A l'aide des instruments manuels diamantés, l'irrégularité des marges est éliminée.

La surface (rouge) non diamantée sur l'extrémité travaillante de l'instrument permet une application guidée tout en utilisant la dent adjacente comme structure d'appui.

Mit den diamantierten Handinstrumenten werden durch manuelles Schleifen die Kavitätenränder nivelliert.

Diamantfreie (rote) Fläche am Instrumentenarbeitsende erlaubt eine am Nachbarzahn abgestützte und geführte Anwendung.

Con l'aiuto degli strumenti diamantati manuali, i margini vengono levigati in modo uniforme. La superficie (rossa) non diamantata sull'estremità operativa dello strumento consente un'applicazione guidata, utilizzando il dente adiacente quale struttura di appoggio, senza il rischio di danni iatrogeni.

With the help of the diamond-coated hand instruments the margins are evenly levelled.

The intended edge angle (red) surface without diamond-coating on the instrument working end allows for a guided application while using the neighbouring tooth as supportive structure.

## Excavateurs

### > Goutte d'eau

Nos excavateurs sont des instruments de précision. Ils sont parfaitement adaptés à leur fonction. Les pointes des lames sont arrondies, elles sont tranchantes, exemptes de bavures et polies.

## Excavatoren

### Wassertropfen

Unsere Excavatoren sind mit Präzision hergestellt. Ihre Formen sind zweckmässig. Ihre Klingenspitzen sind perfekt abgerundet. Die Klingen sind scharf, ohne Grat und sehr fein poliert.

## Escavatori

### Goccia d'acqua

I nostri escavatori sono strumenti di precisione perfetti per le loro funzioni. Le punte delle lame sono arrotondate e rinfinate in modo eccellente; il taglio della lama è estremamente affilato e preciso.

## Excavators

### Water drop

Our excavators are precision manufactured and perfectly adapted for their purpose. Blades are impeccably rounded, with excellent finish on blade surfaces. Cutting edges are extremely sharp and burr free.



0.8 mm



38EX37



0.8 mm

EX081



0.8 mm

EX08



1 mm

32EX31



1.6 mm

22EX21



1.1 mm

EX09



1.1 mm

EX091



1.2 mm

20EX19



1.2 mm

36EX35



1.4 mm

13EX12



1.6 mm

15EX14



1.9 mm

17EX16



## Excavateurs

> Cylindriques

## Excavatoren

Zylindrisch

## Escavatori

Cilindrici

## Excavators

Cylindric



ø 1.2 mm

ø 1.4 mm

ø 1.0 mm

ø 1.5 mm

ø 2.0 mm

**EX182**

**EX18**

**EX31L**

**EX32L**

**EX33L**



## Spatules à ciment

Spatules de qualité supérieure, en acier inox trempé. Ces instruments ont la réputation d'être d'une extrême longévité. Les lames, très planes, assurent un mixage très efficace.

## Zement Spatel

Spatel der Spitzenklasse aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Diese Instrumente sind für ihre äußerst lange Lebensdauer bekannt. Die sehr ebenen Klingen gewährleisten ein sehr effizientes Anmischen.

## Spatole per cemento

Spatole di qualità superiore, in acciaio inossidabile temperato. Questi strumenti sono estremamente duraturi. Le lame, perfettamente piatte, assicurano una miscelazione molto efficace.

## Cement spatulas

Superior, hand crafted spatulas - in hardened stainless steel - these are instruments to last a life-time. Flat blades provide greater mixing efficiency.



**SP5**



SP 10



**SP22**



SP 24



**SP11**



**ZI68**



**SP12**

## Endodontie

## Endodontie

## Endodonzia


## Endodontic

> Sondes à canaux

Kanalsonden

Sonde endodontiche

Root canal explorers

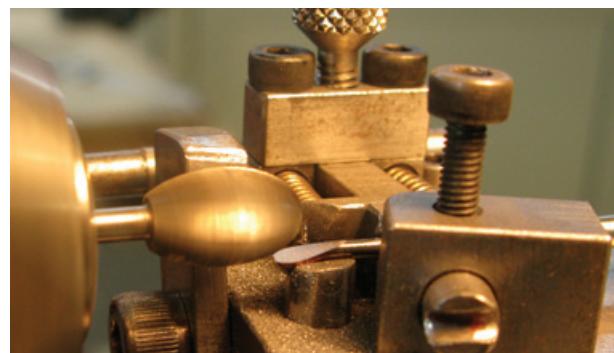

**“Seit mehr als einer Generation setzt die Firma Deppeler sehr erfolgreich einen der höchsten Qualitätsstandards in der Fabrikation dentaler Instrumente durch.”**

*Prof. Dr. Anton Friedmann*

> Micro-miroirs

Micro-Spiegel

Micro-specchietti

Micro-mirrors



**Endodontie****Endodontie****Endodonzia****Endodontic**

- > Fouloirs à canaux condenseurs



*Wurzelkanal-Stopfer  
Kondensatoren*

Otturatori-condensatori

*Root canal condensers*




**Designed by the Dental School of Geneva University**

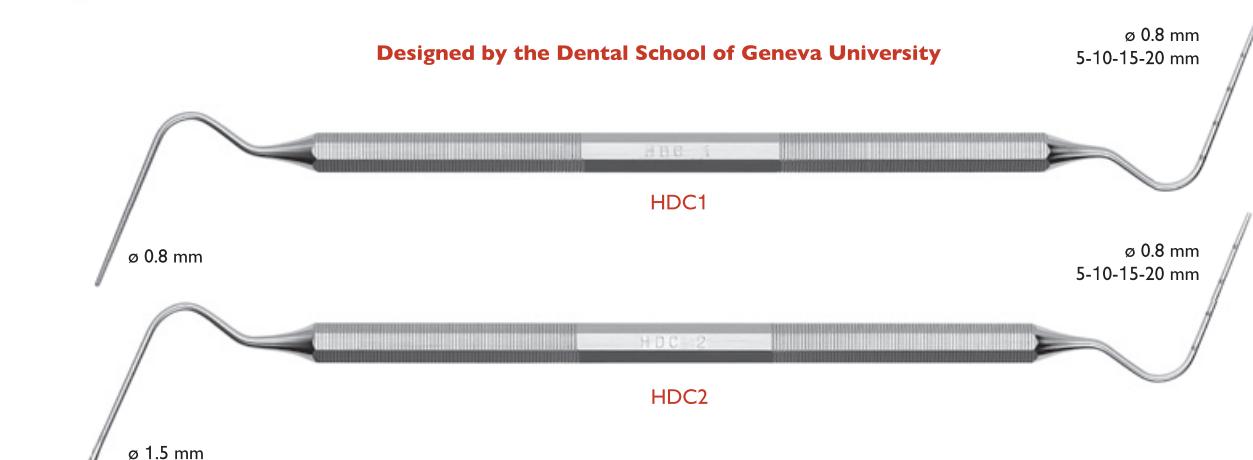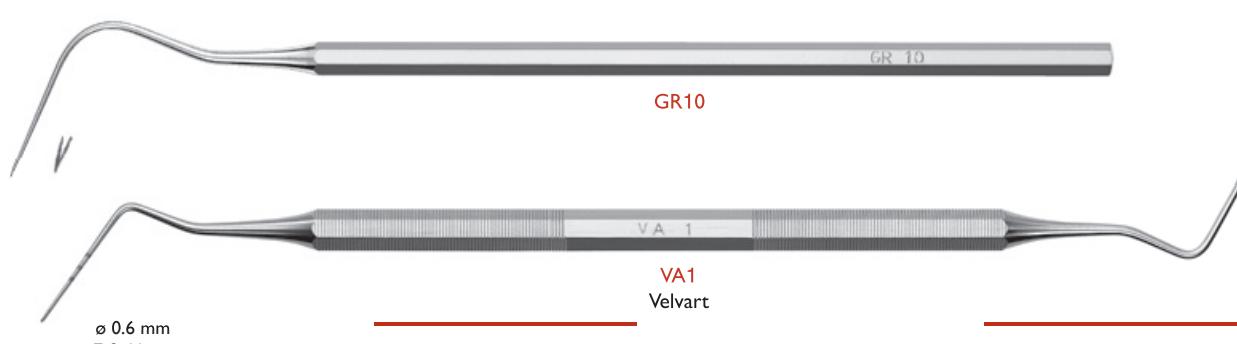**Condenseurs****Kondensatoren****Condensatori****Condensers**

- >  
Pour enlever la guttapercha  
Zum Entfernen der Guttapercha  
Per rimuovere la guttapercha  
For removing the guttapercha

- >  
Pour chauffer la guttapercha  
Zum Erhitzen der Guttapercha  
Per scaldare la guttapercha  
For heating and severing the guttapercha

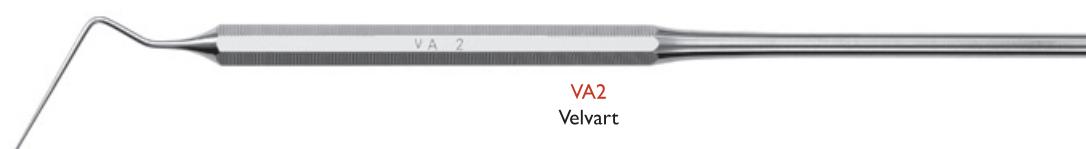**Pour la condensation latérale****Zur lateralen Kondensation****Per la condensazione laterale****Lateral condenser - Spreader**

**Endodontie****Endodontie****Endodonzia****Endodontic**

- Fouloirs pour la condensation verticale

Ci-dessous, un jeu complet de fouloirs pour la condensation verticale des matériaux d'obturation dans le canal radiculaire. Chaque instrument présente une graduation à 5-10-15-20 mm. Le diamètre indiqué correspond à celui mesuré à l'extrémité de la pointe.

- Stopfer für die vertikale Kondensation*

Unten aufgeführt, ein kompletter Satz von Stopfern für die vertikale Kondensation der Füllungsmaterialien im Wurzelkanal. Jedes Instrument hat eine Maßeinteilung bei 5-10-15-20 mm. Der angegebene Durchmesser entspricht dem Spitzenenende.

- Compattatori per la condensazione verticale

Vi presentiamo un set completo di compattatori per la condensazione verticale dei materiali d'otturazione canale. Ogni strumento presenta una graduazione di 5-10-15-20 mm. Il diametro indicato corrisponde a quello misurato all'estremità della punta.

- Pluggers for vertical condensation*

Below, a complete set of pluggers for vertical condensation of filling materials in radicular canal. Each instrument is graduated 5-10-15-20 mm. The diameter indicated corresponds to the tip of the point.

**Fouloirs pour fil de retraction gingivale****Retraktionsfaden-Stopfer****Strumenti per cordino retrattore gingivale****Gingival cord layer**

**Endodontie****Endodontie****Endodonzia****Endodontic**

&gt; Résection apicale

Wurzelspitzen Resektion

Apicotomia

Apicectomy

Scaler

Scaler

Scaler

Scaler



Mini sonde

Mikrosonde

Micro sonda

Micro explorer



Spatule droite/Fouloir boule

Gerader Spatel/Kugelstopfer

Spatola dritta/Otturatore a pallina

Straight spatula/Ball plunger



Spatule coudée/Fouloir boule

Gewinkelter Spatel/Kugelstopfer

Spatola curva/Otturatore a pallina

Bent spatula/Ball plunger



Mini fouloir

Mikrostopfer

Micro otturatore

Micro plunger



Fouloir contre-coudé

Abgewinkelter Seitenzahnstopfer

Otturatore controcurva per laterali

Counter-bent plunger for side teeth



Fouloir pour incisives

Frontzähne-Stopfer

Otturatore per frontali

Front teeth plunger



Curette retro

Retro-Kürette

Retro curette

Retro curette



Fouloir retro

Retro-Stopfer

Otturatore retro

Retro plunger



ø 1.2 mm

ø 1.2 mm

OP65P

ø 1.2 mm





**nos valeurs**  
*unsere werte*  
**i nostri valori**  
*our values*



Deppeler SA fournit aux praticiens des outils d'une qualité irréprochable, répondant parfaitement à leurs demandes.

D'autre part, nous n'avons pas attendu que l'écologie et le développement durable soient à la mode pour les intégrer à la croissance de notre activité.

Notre philosophie est basée sur trois piliers :

1. Ecoute de nos clients
2. Qualité irréprochable de nos produits
3. Conscience environnementale.

*Seit der Gründung besteht das oberste Ziel der Deppeler SA darin, den praktizierenden Ärzten Werkzeuge von einwandfreier Qualität zur Verfügung zu stellen, die ihren Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht werden.*

*Ein weiterer Aspekt der Unternehmensphilosophie besteht darin, dass bei Deppeler nicht erst abgewartet wurde, bis Ökologie und nachhaltige Entwicklung in Mode kamen, sondern diese beiden Faktoren von Anfang an in die Geschäftstätigkeit integriert wurden.*

*Die Unternehmensphilosophie der Deppeler SA gründet auf folgenden drei Grundpfeilern:*

1. Erfüllen der Kundenerwartungen
2. Einwandfreie Produktqualität und
3. Umweltbewusstsein.

---

*Fin dalla sua fondazione, la Deppeler SA fornisce ai professionisti strumenti di una qualità ineccepibile che rispondono perfettamente alle loro esigenze.*

*Inoltre, non abbiamo aspettato che l'ecologia e lo sviluppo sostenibile andassero di moda per integrarli alla crescita della nostra attività.*

*La nostra filosofia poggia su tre pilastri :*

1. *Lascolto dei nostri clienti*
2. *La qualità ineccepibile dei nostri prodotti*
3. *La coscienza ambientale.*

*Ever since it was founded, Deppeler SA has provided dental practitioners with tools of unimpeachable quality, in full keeping with their requirements.*

*What is more, we did not wait for environmental concerns and sustainable development to become fashionable to make them part of our growing activity.*

*Our philosophy is based on three principles:*

1. *Listening to our clients*
2. *The unimpeachable quality of our products*
3. *Environmental awareness.*



**“La philosophie de l’entreprise est axée à la fois sur la fiabilité et la longévité des différents instruments, mais aussi sur l’innovation lorsque de nouveaux produits sont mis au point.”**

*Prof. Dr. Anton Friedmann*



**accessoires & kits**  
*zubehör & kits*  
**accessori & kit**  
*accessories & kits*



<b>57</b>	<b>CLEANext Line</b>	<i>CLEANext Line</i>	<b>CLEANext Line</b>	<i>CLEANext Line</i>
57	> CLEANext B10	> <i>CLEANext B10</i>	> CLEANext B10	> <i>CLEANext B10</i>
57	> CLEANext B5	> <i>CLEANext B5</i>	> CLEANext B5	> <i>CLEANext B5</i>
58	> CLEANext kits	> <i>CLEANext Kits</i>	> CLEANext kits	> <i>CLEANext kits</i>
<b>59</b>	<b>Aiguisage</b>	<i>Schleifen</i>	<b>Affilatura</b>	<i>Sharpening</i>
59	> Machine à aiguiser	> <i>Schleifmaschine</i>	> Apparecchio per l'affilatura	> <i>Sharpening appliance</i>
60	> Pierres à aiguiser	> <i>Schleifsteine</i>	> Pietre per l'affilatura	> <i>Sharpening stones</i>
60	> Huile d'aiguisage	> <i>Schleiföl</i>	> Olio per l'affilatura	> <i>Sharpening oil</i>
60	> Bâtons test	> <i>Test Sticks</i>	> Bastoncini per test	> <i>Test sticks</i>
<b>61</b>	<b>Manches à miroirs</b>	<i>Spiegelgriffe</i>	<b>Manici per specchietti</b>	<i>Mirrors handles</i>
<b>61</b>	<b>Manches ergonomiques</b>	<i>Ergonomische Griffe</i>	<b>Manicotti ergonomici</b>	<i>Ergonomic sleeves</i>
61	> ADEP	> <i>ADEP</i>	> ADEP	> <i>ADEP</i>
61	> FG	> <i>FG</i>	> FG	> <i>FG</i>

## CLEANexttechnology




accessoires

**“Die Instrumente zeichnen sich durch Innovation aus, indem sie immer wieder in Zusammenarbeit mit ausgewählten Klinikern, die zum Teil neu entstehenden Bedürfnisse der Zahnärzte (wie auch der Spezialisten) abzudecken vermögen.”**

*Dr. Jean-Pierre Ebner*

# CLEANext technology

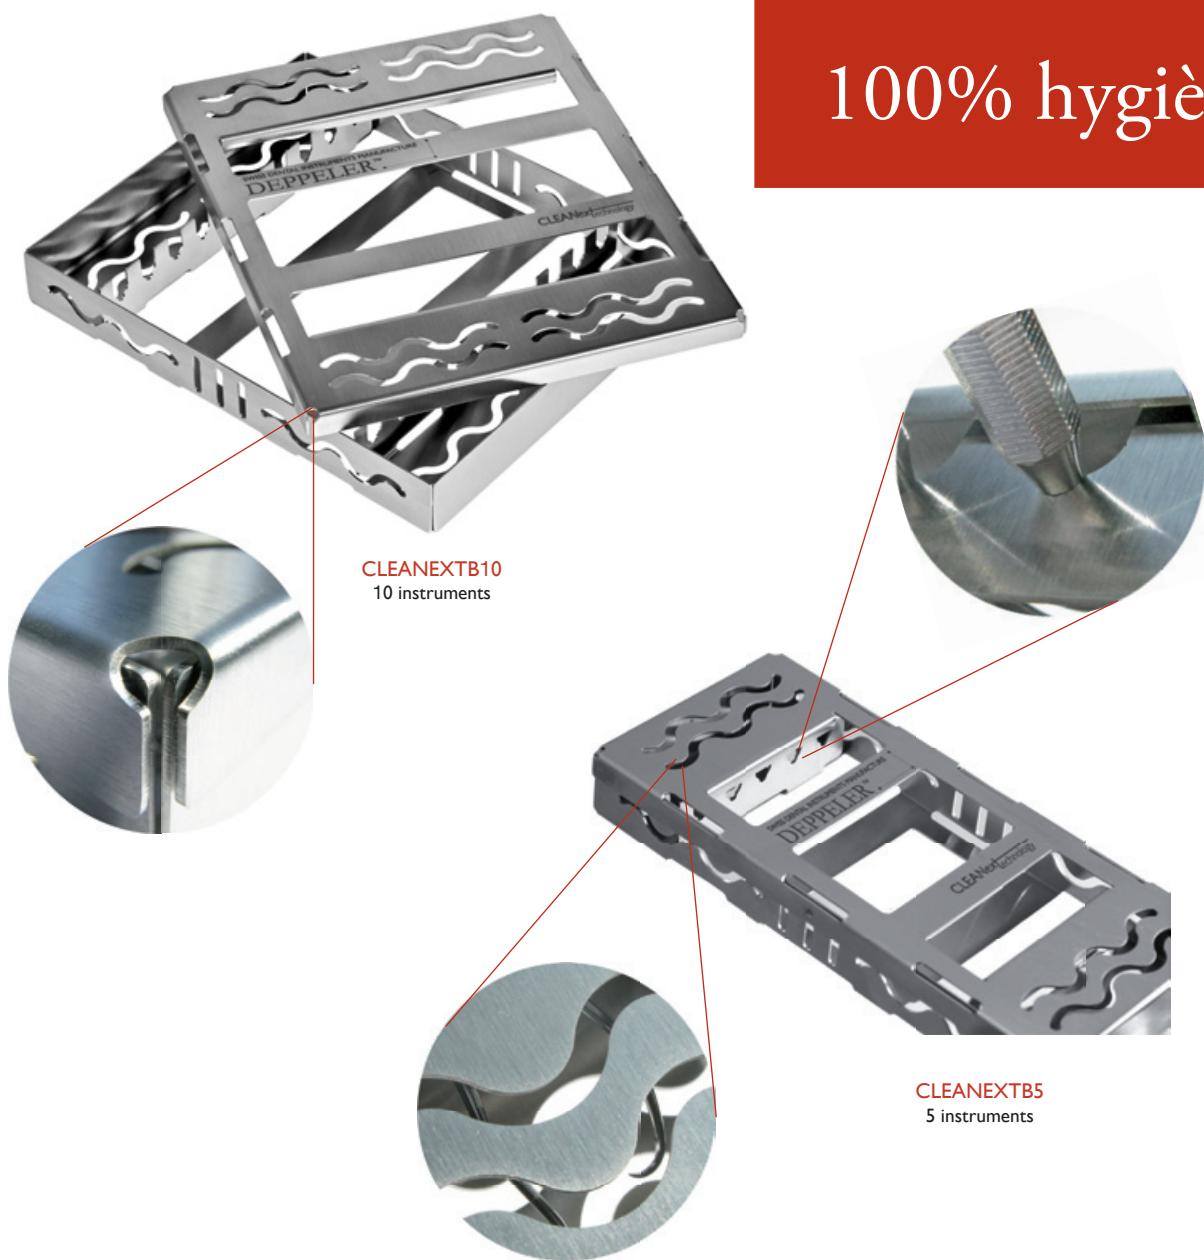

Cette boîte de stérilisation est entièrement conçue pour une hygiène irréprochable.

Ses principaux atouts sont:

- pas de charnière afin d'éviter les dépôts de bactéries,
- système innovant de maintien libre afin d'optimiser le nettoyage,
- couvercle amovible pour plus de praticité,
- tous les angles sont ouverts pour permettre à l'eau de s'évacuer.

Acier de haute qualité

Diese Sterilisations-Kassette wurde für eine komplett einwandfreie Hygiene konzipiert.

Seine Hauptvorteile sind:

- keine Scharniere, die eine Ablagerung von Bakterien ermöglichen,
- optimale Sterilisation durch ein innovatives freies Halterungs-System,
- abnehmbarer Deckel zum besseren Hantieren,
- die offenen Ecken erlauben einen guten Abfluss.

Hoch qualitativer Stahl

Questo portastrumenti per la sterizzazione è stato concepito per garantire la massima igiene.

Le sue carte vincenti sono:

- assenza di cerniere per evitare i depositi di batteri,
- area di conato minima per ottimizzare la sterizzazione,
- coperchio amovibile per maggiore praticità,
- angoli aperti che permettono all'acqua di evacuare facilmente.

Acciaio inossidabile di alta qualità

This sterilisation box has been designed for impeccable hygiene.

Its main advantages:

- no hinge thus preventing bacterial deposits,
- optimal sterilisation through an innovative free support system,
- removable cover for ease of use,
- open corners for an optimal flow and avoid dirt clusters.

High quality stainless steel

## CLEANext kits



### KITHYGIENE1

Standard scaling and diagnostic kit  
DH2+ADEP Explorer  
M23+ADEP Scaler  
M23A+ADEP Curette  
Mirror DMS  
PP12DMS Paro probe + 3 exchange tips (color code 3-6-9-12mm)

## CLEANext Kits



### KITHYGIENE2

Standard paro kit  
5GE6+ADEP Gracey Classic  
7GE8+ADEP Gracey Classic  
11GE12+ADEP Gracey Classic  
13GE14+ADEP Gracey Classic  
PP12DMS Paro probe + 3 exchange tips (color code 3-6-9-12mm)

## CLEANext kits



### KITIMPLANT

Kit for implant treatments in pure titanium  
AD23LDMS univ. curette left  
AD23RDMS univ. curette right  
TI67LDMS sickel univ. curette left  
TI67RDMS sickel univ. curette right  
PP12DMS Paro probe + 3 exchange tips (color code 3-6-9-12mm)

## CLEANext kits



### KITFURCATION

Kit for the treatment of furcations  
ZA3 Furcation-probe (3-6-9-12mm)  
F10 Universal curette for slightly open furcations  
F11 Universal curette for wide open furcations  
F12 Diamond-coated curette to smooth the furcations  
F13 Diamond-coated curette to smooth the furcations



### KITMINI

Mini invasive periodontal kit  
5PM6+ADEP Gracey curette Mini Profil  
7PM8+ADEP Gracey curette Mini Profil  
11PM12+ADEP Gracey curette Mini Profil  
13PM14+ADEP Gracey curette Mini Profil  
M23F+ADEP fine universal scaler  
M23AS+ADEP fine universal curette  
DH2+ADEP Explorer  
PP12DMS (+3 recharge tips) Pocket probe (3-6-9-12mm)  
MirrorDMS



### KITSURGERY

Mini invasive surgery kit  
VA4 Micro mirror  
VA7 Micro probe  
VA8 Mini scaler  
VA10 Combination mini plugger-spatula  
VA12 Mini plugger  
VA14 Mini plugger  
VA21 Surgery curette  
VA16 Surgery curette, periosteal elevator  
P10 College tweezer



### KITCROCT

Restorative Kit-Titanium nitrid  
Copro1CT  
Copro2CT  
Copro3CT  
Copro4CT  
Copro5CT  
more p.31



### KITPRO

Restorative Kit-Classic  
Copro1  
Copro2  
Copro3  
Copro4  
Copro5  
more p.31



### KITRESTOC

Standard restorative Kit-Classic  
OP3C Combination spatula, plugger  
OP46DC Plugger  
OP55C Spatula  
125C Ball plugger  
HZ3C Modelling instrument

### KITRESTOCT


Standard restorative Kit-Titanium nitrid  
OP3CT  
OP46DCT  
OP55CT  
125CT  
HZ3CT

### KITRESTOX

Standard restorative Kit-Shadeline  
OP3X  
OP46DX  
OP55X  
125X  
HZ3X

## &gt; Easy Sharp®

Perfect sharp without wasting material. Same angle before and after sharpening.

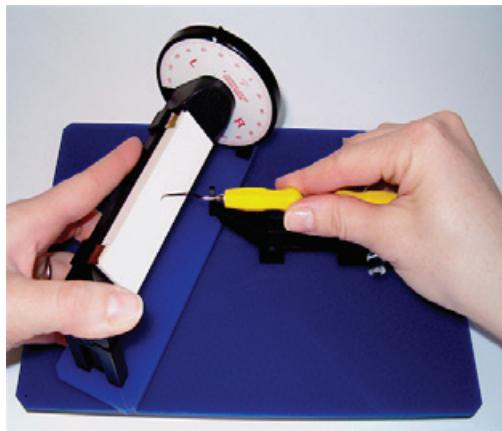


Non seulement fabriquons-nous les meilleurs scalers et curettes, mais nous avons aussi l'appareil pour les aiguiser: Easy-Sharp® permet d'affûter nos scalers, curettes et ciseaux à émail de manière précise, rapide et sûre. Le mode d'emploi livré avec l'appareil donne les angles à régler, le positionnement des instruments et les divers mouvements à exécuter. Livré avec les pierres ES800 et A608.

Wir stellen nicht nur die besten Scalers und Kuretten her, sondern auch das Gerät, um sie zu schleifen. Easy-Sharp® ermöglicht das Schleifen unserer Scalers, Kuretten und Schmelzmesser auf genaue, schnelle und sichere Weise. Die mit dem Gerät gelieferte Gebrauchsanweisung erläutert die einzustellenden Winkel, das Positionieren der Instrumente und die verschiedenen, auszuführenden Bewegungen. Wird mit den Schleifsteinen ES800 und A608 geliefert.

Noi non fabbrichiamo soltanto i migliori scalar e curette, ma abbiamo anche l'apparecchio per affilarli. Easy-Sharp® permette infatti d'affilare in maniera precisa, rapida e sicura, scalar, curette e tagliasmalto. Le istruzioni d'uso, fornite con l'apparecchio, indicano gli angoli da regolare, la posizione degli strumenti e i diversi movimenti da effettuare. Fornito con le pietre ES800 e A608.

Not only do we make the best curettes, we also have the appliance to sharpen them. Easy-Sharp® lets you sharpen our scalers, curettes, gingival margin trimmers and chisels quickly, accurately and surely. Instructions for use and specification tables delivered with the device provide details on positioning instruments, adjusting angles and the correct movements to use. Delivered with stones ES800 and A608.

*Coming soon : the new easy Sharp!*

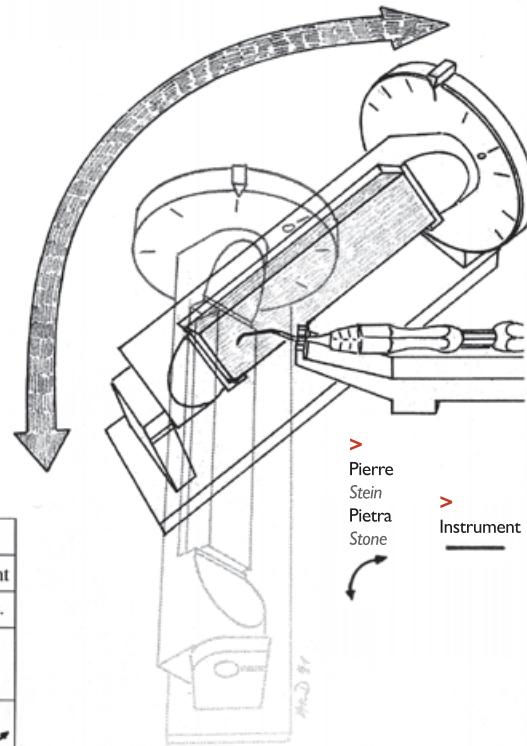

## Scalers and Curettes

Item Nr.	Angle		Position Face 1	Position Face 2	Movement	
	Face 1	Face 2			Stone	Inst.
Rigid Gracey 11 GC 12	60°L	—				—
Rigid Gracey 13 GC 14	18°L	—				
Univ. Curette GE 22	20°L	20°L				
Gracey 1 GE 2	47°L	—				—
Gracey 3 GE 4	47°L	—				
Gracey 5 GE 5						

## Aiguisage

> Pierres à aiguiser



**MS34**  
India Medium  
~45 x 115 x 10/5 mm

## Schleifen

Schleifsteine



**RAO800**  
Ceramic Arkansas  
~37 x 100 x 8/3 mm

## Affilatura

Pietre per l'affilatura

## Sharpening

Sharpening stones



**A619**  
Ceramic Arkansas  
~25 x 115 x 5/2 mm




**HS14**  
Genuine Arkansas  
~30 x 100 x 7.3/5 mm



**A608**  
Ceramic Arkansas  
~25 x 100 x 6 mm.



**ES800**  
Ceramic Arkansas  
~25 x 100 x 12 mm

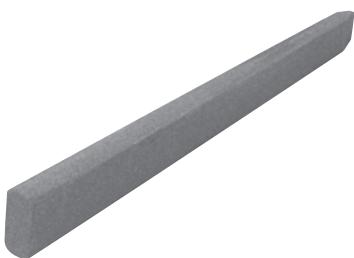

**C309**  
Carborundum  
~14/8 x 100 x 6.2 mm



**MF464**  
India Medium  
~13/8 x 103 x 6 mm



**MF433**  
India Medium  
~11 x 90 x 4 mm



**TEST-STICK**

>  
Bâtons test  
paquets de 6 pces  
Teststäbchen  
Packungen von 6 Stk.  
Bastoncini per test  
conf. da 6 pezzi  
Test sticks  
packs of 6 pces



**OIL**  
50ml

>

Sélectionnée pour vous cette huile est certifiée FDA, inodore, incolore et comestible. Sa fluidité permet d'optimiser votre travail d'aiguisage. FDA-zertifiziert, geruchlos, farblos und essbares Öl. Seine Fließfähigkeit erlaubt ein optimales schleifen. Olio certificato FDA, inodore, incolore e commestibile. La sua fluidità permette un affilatura ottimale. FDA-certified, odourless, colourless and edible oil. Its fluidity allows optimal sharpening.

## Manches à miroirs

## Spiegelgriffe

## Manici per specchietti

## Mirrors handles



DMS-V



DMS-N

Manche pour miroirs et pour pointes à vis. Supporte la stérilisation jusqu'à 200°C. Ergonomique et confortable. Livrable en vert et en noir.

Spiegel- und Ansätze-Griff aus Plastik hergestellt. Verträgt die Sterilisierung bis 200°C. Handförmung, angenehm, in grün und schwarz lieferbar.

Manico in plastica per specchietti e per strumenti con attacco a vite. Sterilizzabile fino a 200°C. Colore verde e nero.

Mirrors and screw tips handle, made of plastic, sterilizable up to 200°C. Delivered in green or black. Ergonomic and comfortable.

## Manches en silicone ergonomiques

## Ergonomische Silikon-Griffhülsen

## Manicotti in silicone ergonomici

## Silicone ergonomic sleeves

ADEP SLEEVES



>  
Sterilisable jusqu'à 200°C  
Sterilisierbar bis 200°C  
Sterilizzabili fino a 200°C  
Sterilizable up to 200°C



FG SLEEVES



## FG Sleeves

>  
Rond  
Rund  
Tondo  
Round

Manchons ergonomiques, qui évitent crispations et douleurs. Nous livrons ces manchons déjà montés sur les instruments ou séparément; ADEP: paquets de 4 pièces FG: paquets de 12 pièces

Voir mode d'emploi p. 62

Weiche, ergonomische Griffe, die Verkrampfungen und Schmerzen vermeiden. Wir liefern diese Hülsen schon auf die Instrumente montiert oder getrennt; ADEP: Packungen von 4 Stück FG: Packungen von 12 Stück

Siehe Gebrauchsanweisung S. 62

Manicotti ergonomici, in materiale plastico, che evitano contrazioni e dolori. Forniamo questi manicotti già montati sugli strumenti o separatamente; ADEP: conf. da 4 pezzi FG: conf. da 12 pezzi

Vedi istruzione d'uso pagina 62.

Soft, ergonomic handles for prevention of contractions and pain. These sleeves are delivered ready-mounted on the instruments or separately, in packs; ADEP : packs of 4 pieces FG : packs of 12 pieces

See instructions for use p. 62.

**entretien**  
**wartung**  
**manutenzione**  
**maintenence**

**Pour les curettes en titane**

**Recommandations**

Les instruments doivent être correctement réaffûtés car avec le titane le manque de tranchant ne peut être compensé par un surplus de force, la pièce risquant de se déformer.

Comme les caractéristiques mécaniques du titane sont différentes de celles de l'acier, lors du travail avec une curette en titane, la force à transmettre doit être bien dosée, pour que l'instrument ne soit pas déformé.

L'affûtage d'une curette à implant en titane doit être effectué sur une pierre réservée à ce seul usage afin de ne pas contaminer l'instrument par des particules d'acier pouvant agresser l'implant.

La stérilisation du titane ne nécessite aucun réglage particulier.

**Für die Titan Kuretten**

**Empfehlungen**

Die Instrumente müssen unbedingt korrekt geschliffen werden. Ein Mangel an Schärfe lässt sich nämlich nicht durch einen zusätzlichen Kraftaufwand wettmachen, weil sich das Material ansonsten verformt.

Da sich die mechanischen Eigenschaften des Titans von denjenigen des Stahls unterscheiden, muss die Kraft beim Arbeiten mit Titan-Kuretten genau dosiert werden.

Der Schliff einer Implantat-Kürette aus Titan hat auf einem eigens zu diesem Zweck reservierten Stein zu erfolgen. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Instrument nicht durch Stahlpartikel verunreinigt wird, die das Implantat beeinträchtigen könnten.

Das Sterilisieren von Titan bedarf keiner besonderen Regelung.

**Per le curette in titanio**

**Modalità d'uso**

Gli strumenti vanno affilati correttamente poiché la mancanza di tagliente non può, con il titanio, essere compensata da una maggiore forza che rischierebbe di deformare il pezzo.

Essendo le caratteristiche meccaniche del titanio diverse da quelle dell'acciaio, quando si lavora con una curetta in titanio, la forza da trasmettere va dosata correttamente, in modo che lo strumento non venga deformato.

L'affilatura di una curetta per impianti in titanio va effettuata su una pietra riservata a questo unico uso per non contaminare lo strumento con particelle di acciaio che potrebbero aggredire l'impianto.

La sterilizzazione del titanio non richiede nessuna procedura particolare.

**For the titanium curettes**

**Instructions for use**

The instruments should be resharpened to the correct degree, as with titanium, the lack of cutting ability can not be compensated by excess force, with the risk that the tool may become misshapen.

As the mechanical properties of titanium are different from those of steel, when working with a titanium curette you should carefully gauge the force to be applied, so that the instrument does not lose its shape.

Titanium curettes should be sharpened on a stone reserved for this purpose alone, so as not to contaminate the instrument with steel particles that may damage implants.

No special adjustments need to be made for the sterilisation of titanium.

**Pour les manches en silicone ADEP**

**ADEP + FG**

**Montage**

Plongez ces douilles en caoutchouc silicone durant environ vingt secondes dans de la benzine médicinale, une par une. Montez les douilles sur le manche, une par une. Protégez la pointe des lames d'instruments avec un morceau d'isolant de fil électrique, pour éviter de blesser le canal du manchon. Ce mode de faire assure une fixation hermétique. Ne pas dépasser 45 secondes d'immersion dans la benzine. Pendant le montage, évitez de mettre les vapeurs de benzine en contact avec une flamme ou une étincelle.

**Entretien**

Lors de la désinfection et du lavage, respectez les concentrations recommandées des produits. Ne pas dépasser les temps recommandés. Rincer très soigneusement après ces opérations afin d'éviter la coloration des manchons.

**Für die ADEP Silikon Griffhülsen**

**ADEP + FG**

**Einsetzung**

Die Hülsen aus Silikongummi etwa zwanzig Sekunden in medicinisches Benzin tauchen, eine nach der anderen. Die Hülsen dann auf den Griff des Instrumentes schieben, eine nach der anderen. Die Spitze der Instrumenten-Klingen mit einem Stück elektrischen Draht-Isolierstoff schützen, um die Hülsen nicht zu verletzen. Diese Anwendungweise erlaubt eine dichte Befestigung. Nicht länger als 45 Sekunden ins Benzin tauchen. Während des Vorganges die Benzindüste nicht mit einer Flamme bzw. einem Funken in Kontakt bringen.

**Wartung**

Beachten Sie die empfohlene Konzentration und Zeitdauer für Desinfektion und Reinigung. Spülen Sie die Instrumente sorgfältig, um eine eventuelle Verfärbung der Griffe zu vermeiden.

**Per i manicotti in silicone ADEP**

**ADEP + FG**

**Montaggio**

Immergete i manicotti di gomma di silicone per 20 secondi in benzina medicinale, uno per volta. Montate i manicotti sul manico, uno per uno. Proteggete la punta delle lame degli strumenti con un pezzo d'isolante per filo elettrico, per evitare d'incidente il canale del manicotto. Questo procedimento assicura un fissaggio ermetico. Non oltrepassare i 45 secondi d'immersione nella benzina. Durante il montaggio, evitate di far entrare in contatto i vapori di benzina con una fiamma o una scintilla.

**Manutenzione**

Al momento della disinfezione e del lavaggio, rispettare le concentrazioni dei prodotti raccomandate. Non superare i tempi raccomandati. Sciacquare molto accuratamente dopo queste operazioni per evitare la colorazione dei manicotti.

**For the ADEP silicone handles**

**ADEP + FG**

**Fitting**

Dip the silicone rubber sleeves into Petroleum Spirit (Benzinum Medicinale) for about twenty seconds, one at a time. Then slide them on to the instrument handle, one by one. Protect the tip of the blade with a piece of electric wire insulating to avoid scratching the inside of the sleeve. This process ensures a tight fit. Do not immerse the sleeves in the Petroleum Spirit for more than 45 seconds. Petroleum Spirit vapours are highly inflammable. Keep away from sparks or an open flame.

**Maintenance**

When disinfecting and washing, respect the recommended concentrations for the products used. Do not exceed the recommended times. Rinse very carefully afterwards to prevent discoloration of the handle sleeves.

# Mode d'Emploi & Fiche de Sécurité

## MISE EN GARDE GENERALE

Les instruments présentés dans ce catalogue ne sont pas vendus sous emballage stérile. Ils ne doivent être utilisés que pour l'usage auquel ils sont destinés et uniquement par des professionnels de l'art dentaire. Il ne faut en aucun cas essayer de redresser un instrument déformé après une chute; il pourrait alors facilement se casser.

## A RECEPTION DES INSTRUMENTS

Sortir de l'emballage avec prudence. Contrôle visuel. Lavage et stérilisation selon les normes en vigueur.

## STOCKAGE

Les instruments neufs non encore stérilisés doivent être stockés dans leur emballage, à part, avec mention NON STERILE. Les instruments aussi bien neufs que stérilisés sont entreposés à l'abri de toute contamination, de l'humidité, de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs corrosives.

## TRANSPORT AU CABINET

Transporter les instruments avec prudence, de préférence dans un récipient fermé pour éviter tout incident (contamination-blessure).

## DESINFECTION - LAVAGE

Après utilisation, ne pas laisser sécher les dépôts organiques ou les matériaux d'obturation sur les instruments. La désinfection et le lavage dans un bain à ultra-sons sont recommandés. Les directives du fabricant, à savoir les concentrations des produits de désinfection et de lavage, les temps et les températures recommandés sont à respecter scrupuleusement. Les instruments seront rincés soigneusement et longuement après désinfection. Pendant toutes ces manipulations, porter des gants de protection et traiter les instruments avec délicatesse pour éviter chocs, déformations et/ou ruptures.

## STERILISATION

Stériliser selon les normes en vigueur. Ensuite conditionner les instruments à l'abri de toute contamination. N'utiliser en autoclave que de l'eau déminéralisée ou distillée. Le stérilisateur doit être maintenu propre.

## RE-AIGUISAGE

Les instruments tranchants, curettes et scalers doivent être aiguisés régulièrement. L'aiguissage répété diminue la section des lames. Il s'ensuit un affaiblissement de la lame et un risque de rupture. Le praticien doit apprécier lui-même le moment d'éliminer un instrument, selon son expérience et sa sensibilité. Un aiguissage mal effectué est synonyme de risque de rupture. Nous fournissons des appareils très performants pour l'aiguissage des instruments.

## CORROSION

Le chlore et les produits chlorés sont dangereux pour l'acier inoxydable. L'eau chlorée provoquera une corrosion par piqûres. L'eau du réseau contient de la rouille qui se dépose sur les instruments et provoque une corrosion ultérieure.

plus d'informations sur [www.deppeler.ch](http://www.deppeler.ch)

## Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise

## GENERELLE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem Katalog gezeigten Instrumente werden nicht in sterilen Verpackungen verkauft. Sie dürfen nur für Aktivitäten im Zahnartztbereich verwendet werden und das nur von geschultem Personal im Zahnartztbereich. Solte ein Instrument zu Boden fallen und sich deformieren, darf es auf keinen Fall zurechtgebogen werden, da es dann leicht brechen könnte.

## BEI ERHALT VON INSTRUMENTEN

Nehmen Sie die Instrumente vorsichtig aus der Verpackung. Überprüfen Sie sie sorgfältig. Reinigung und Sterilisation derselben sollten gemäss der bestehenden Normen durchgeführt werden.

## LAGERUNG

Neue Instrumente, die noch nicht sterilisiert wurden, müssen separat und mit dem Vermerk "NICHT STERILISIERT" gelagert werden. Neue Instrumente sowie solche die sterilisiert wurden, müssen so gelagert werden, dass sie weder mit Verunreinigung, Feuchtigkeit oder korrosiven Chemikalien oder Gasen in Berührung kommen.

## TRANSPORT IN DIE PRAXIS

Tragen Sie die Instrumente vorsichtig und vorzugsweise in einem geschlossenen Behälter, um einen möglichen Unfall auszuschliessen (Verunreinigung-Verletzung).

## DESINFektION - WÄSCHE

Nach Verwendung, lassen Sie keine organischen Rückstände oder Teile einer Extraktion auf den Instrumenten eintrocknen. Es wird empfohlen, die Instrumente zu desinfizieren und in einem Ultraschall-Bad zu waschen. Bitte folgen Sie der Empfehlung des Herstellers in Bezug auf Konzentration des Desinfektionsproduktes und der Wäsche. Die Anwendungsdauer und die empfohlenen Temperaturen sind auf das Genaueste einzuhalten. Die Instrumente werden nach der Desinfektion lange und gründlich gespült. Während dieser Tätigkeiten tragen Sie bitte Handschuhe und behandeln Sie die Instrumente mit Vorsicht um Schocks, Deformationen und/oder Brüche zu verhindern.

## STERILISATION

Sterilisieren Sie gemäss der derzeit bestehenden Normen. Die Instrumente müssen anschliessend fern von jeder Möglichkeit einer Verunreinigung aufbewahrt werden. Verwenden Sie nur sterile oder entmineralisiertes Wasser in Autoclaven. Der Sterilisator muss auf jeden Fall rein gehalten werden.

## SCHÄRFEN

Schneidende Instrumente wie Kuretten und Scalers müssen regelmässig geschärft werden. Durch wiederholtes Schärfen wird die Klinge reduziert. Das Blatt wird dadurch geschwächt und ein eventuelles Brechen ist möglich. Deshalb muss der Verwender eines Instruments durch seine Erfahrung selber entscheiden, wann es nicht mehr verwendet werden kann. Falsches Schärfen bringt das Risiko, dass das Instrument bricht. Wir können hoch effiziente Apparate zur Instrumentenschärfung liefern.

## KORROSION

Chlor und Chlor-Produkte sind für rostfreien Stahl gefährlich. Chlorhaltiges Wasser ruft eine punktförmige Korrosion hervor. Leitungswasser enthält Rost, der sich an den Instrumenten absetzt und eine weitere Korrosion hervorruft.

mehr Informationen auf [www.deppeler.ch](http://www.deppeler.ch)

## Istruzioni & Avvertenze

### AVVERTIMENTO GENERALE

Gli strumenti presentati in questo catalogo non sono venduti in imballaggio sterile. Devono essere utilizzati soltanto per l'uso cui sono destinati e solamente dai professionisti dell'odontoiatria. Non si deve in nessun caso provare a raddrizzare uno strumento deformato in seguito ad una caduta in quanto si potrebbe facilmente rompere.

### ALL'ATTO DI RICEVIMENTO DEGLI STRUMENTI

Togliere l'imballaggio con prudenza. Eseguire un controllo visuale. Lavare e sterilizzare secondo le norme in vigore.

### STOCCAGGIO

I nuovi strumenti non ancora sterilizzati devono essere posti separatamente nel loro imballaggio, con la menzione NON STERILE. Gli strumenti nuovi e sterilizzati devono essere conservati al riparo da qualsiasi contaminazione, umidità, prodotti chimici o vapori corrosivi.

### TRASPORTO ALLA SEDE DI LAVORO

Trasportare gli strumenti con prudenza, preferibilmente in un contenitore chiuso per evitare qualsiasi incidente (contaminazione-ferita).

### LAVAGGIO - DISINFEZIONE

Dopo l'utilizzo, non lasciar seccare i depositi organici o i materiali d'otturazione sugli strumenti. E' consigliata la disinfezione ed il lavaggio ad ultrasuoni. I consigli del fornitore, ovvero le concentrazioni dei prodotti per la disinfezione ed il lavaggio, i tempi e le temperature suggerite, devono essere rispettati scrupolosamente. Gli strumenti vanno risciacquati con attenzione ed abbondantemente dopo la disinfezione. Durante l'utilizzo, portare i guanti protettivi. Maneggiare gli strumenti con delicatezza per evitare deformazioni e/o rotture.

### STERILIZZAZIONE

Sterilizzare secondo le norme in vigore. Conservare al riparo da qualsiasi contaminazione. Nell'autoclave, usare soltanto acqua demineralizzata o distillata. Lo sterilizzatore deve essere mantenuto pulito.

### AFFILATURA

Gli strumenti taglienti devono essere affilati regolarmente. L'affilatura ripetuta fa diminuire la sezione delle lame : ne consegue un indebolimento delle stesse ed un rischio di rottura. L'utilizzatore deve sapere quando uno strumento va eliminato, secondo la sua esperienza e la sua sensibilità. Un'affilatura mal effettuata è sinonimo di rischio di rottura. Gli apparecchi forniti per l'affilatura degli strumenti sono molto efficaci.

### CORROSIONE

Il cloro ed i prodotti clorati sono pericolosi per l'acciaio inossidabile. L'acqua clorata provocherà una corrosione per via idrica. L'acqua della rete contiene della ruggine che si deposita sugli strumenti e provoca una corrosione ulteriore.

maggiori informazioni su [www.deppeler.ch](http://www.deppeler.ch)

## Usage Instructions & Safety Sheet

### GENERAL PRECAUTION

The instruments presented in this catalogue are not sold in sterile packs. They are for use exclusively by professional dentists and for no other purpose than dentistry. In no circumstances should an instrument which has been dropped and bent be re-straightened because it could then break easily.

### INSTRUMENT DELIVERY

Remove the instruments from their pack with care. Check them carefully. Washing and sterilisation should be carried out according to current standards.

### STORAGE

New instruments which have not yet been sterilized must be stored in a separate location and clearly labeled NON-STERILE. Both new as well as sterilized instruments should be stored protected from sources of contamination, dampness, corrosive chemicals or gases.

### TRANSPORT TO THE SURGERY

Transport the instruments with care preferably in a closed container to avoid accidents (contamination-injury).

### DISINFECTION - WASHING

After use, do not leave traces of organic or extraction matter to dry on the instruments. Disinfection and washing in an ultra-sound bath is recommended. Please follow the instructions provided by the manufacturer, and particularly the recommended concentrations and the times and temperatures of disinfectants and rinses. After disinfection instruments should be thoroughly rinsed several times. Protective gloves should be worn while carrying out these operations. To prevent accidents which could bend or break them, the instruments should be handled at all times with great care.

### STERILISATION

Carry out this operation respecting the current norms. Afterwards the instruments should be stored away from any possible sources of contamination. Use only sterile or distilled water in autoclaves. The sterilizer must be kept absolutely clean.

### RE-SHARPENING

Cutting instruments, curettes and scalers must be sharpened regularly. Frequent sharpening reduces the cutting edge of blades. This results in a weakening of the blade and the consequent risk of breakage. Therefore, on the basis of his experience and judgment the user must decide when an instrument must be discarded. Faulty sharpening means risk of breakage. We supply very efficient apparatus for instrument sharpening.

### CORROSION

Chlorine and chlorinated products are dangerous for stainless steel. Chlorinated water produces pitting corrosion. Tap water causes rust on instruments and further corrosion.

more information on [www.deppeler.ch](http://www.deppeler.ch)

index par article		CLEANEXTB10	57	250EX	45	HR18	20
<i>index pro artikel</i>		CLEANEXTB5	57	150/250EXKIT	45	HS14	60
<i>indice per articolo</i>		CPRO1	31	EZI70	8	Huile pour pierres	60
<i>index per article</i>		CPRO2	31	F	F10®	HZ3C	39
<b>A</b>	A608	CPRO3	31	F11®	14	HZ3CT	43
	A619	CPRO4	31	F12	14	HZ3X	34
AD10		CPRO5	31	F13	14	HZ7	53
AD23L®		CPRO1CT	31	FG SLEEVES	14	HZ8	40
AD23LDMS®		CPRO2CT	31	61	HZ9	40	
AD23R®		CPRO3CT	31		HZ22	40	
AD23RDMS®		CPRO4CT	31		HZ25C = HZ25	39	
AD33		CPRO5CT	31		HZ25CT	43	
ADEX SLEEVES		123CT = 123CT124	42		HZ25X	34	
AF1		124CT	42				
AF2		125CT	42	11GD12 = 11MD12	18	<b>K</b> 16K15	27
AF3		126CT	42	13GD14 = 13MD14	18	KHR12 (K12)	7
AF4		127CT	42	GE8	6	KHR12DMS	7
AF5		CU1	26	GE22	14	KITCPRO	58
AF6		CU2	26	1GE2	17	KITCPROCT	58
AF7		CU3	26	3GE4	17	KITFURCATION	58
AF8		CU5	26	5GE6	17	KITHYGIE1	58
AF9		CU7	26	5GE6CN	21	KITHYGIE2	58
AF10				7GE8	17	KITIMPLANT	15/58
AF30						KITMINI	58
AL1		<b>D</b> DH2™	5	7GE8CN	21	KITRESTOC	58
AL2		DH3	5	9GE10	17	KITRESTOCT	58
AL3		DH34	5	11GE12	17	KITRESTOX	58
AL5		DH34S	5	11GE12CN	21	KITSURGERY	58
AL7		DHB11 (D11)	7	13GE14	17		
AP67		DHB11DMS	7	13GE14CN	21		
		DHZ12 (D12)	7	15GE16 = 11SM12S	17	<b>L</b> L2	26
		DHZ12DMS	7	17GE18 = AR34	17	L3	26
		DM1	47	GP03	53	L5	26
<b>B</b> Bâtons test (6p.)		DM2	47	GP04	53	L7	26
22BE12		DMS-N	61	GP05	53	LPR	28
BP1		DMS-V	61	GP06	53		
BR086				GP07	53	<b>M</b> 11M12	19
1BR2						13M14	19
2BR3		<b>E</b> EASY-SHARP®	59	GP08	53	M15	11
08BR06		EB2	27	GP09	53	■ M21	11
08SBR06S		EL00	29	GP10	■	M21F	12
10BR08		EL00S	29	GP12	■		
10SBR08S		EL01	29	GR1	27	M23™	9/11
24BR25		EL01S	29			M23A™	13
25BR26		EL1	29	GR10	52	M23ACN	21
26BR27		EL15	29	GR16	51	M23AS	14
27BR27S		EL15S	29	GX1	11	M23CN	9/21
27SBR27SS		EL16	29	GX2	19	M23F	12
28BR29		EL16S	29	GX3	13	MB1C	38
BT7		EL18	29	GX4™	13	MB1CT	43
		EL18D	29	GX4S	14	MB1X	34
		EL18DS	29	GX5	20	MB2C	38
<b>C</b> 123C = 124SBR124		EL18S	29	GX6	20	MB2CT	43
124C = 124BR125		EL20	29	GX7	27	MB2X	34
125C = 125BR126		EL21	29	GX8	27	MB3C	39
126C = 126BR127		EL21S	29	GX11	27	MB3CT	43
127C = 127BR127S		EL96	29	GY12 (G12)	7	MB3X	34
C309		EL97	29	GY12DMS	7	MB4C	35
CI3		EL98	29				
15CI16		EL99	29	<b>H</b> H533	11	MB4CT	41
26CI27		EL20	29	H6H7	11	MB4X	32
28CI29		EL21	29	H125	7	MB5C	35
32CI33		ES800	60	HD16	24	MB5CT	41
34CI35		EX08	49	HD17	24	MB5X	32
CI38		EX081	49	HDC1	52	MB6C	37
41CI42		EX09	49	HDC2	52	MB6CT	42
43CI44		EX091	49	5HG6 + ADEP	19	MB6X	33
77CI78		13EX12	49	7HG8 + ADEP	19	14MC13	13
79CI80		15EX14	49	11HG12 + ADEP	19	MF1	40
83CI83D		17EX16	49	13HG14 + ADEP	19	MF2C	39
CI84		EX18	50	HH11 (H11)	7	MF2CT	43
CI85		20EX19	49	HH11DMS	7	MF2X	34
177CI178		22EX21	49	HH12 (H12)	7	MF40A	48
179CI180		EX31L	50	HH12DMS	7	MF40P	48
277CI278		EX32L	50	HO1	7	MF433	60
279CI280		32EX31	49	HO2	8	MF464	60
CK10		EX33L	50	HO3	24	MS34	60
CK28BC = CK28B		36EX35	49	HO4A	27	1MY2	13
CK28BCT		38EX37	49	HO4B	27	3MY4	13
CK28BX		EX182	50	HP551	11		
		150EX	45	HR17	20	<b>N</b> NP2C	8

NS2	■	OP91	44	3Sj4S	27	31VT32	20
37NS36	47	OP92	44	SM17	40	34VT33	20
62NS61	47	OP300C	36	SM17D	40	35VT36	20
66NS65	47	OP311C	36	SM18	40		
		OP551C	35	SM19	40	<b>W</b> WHO (W)	7
● Oil for stones	60	OP551CT	41	SM20	40	WHODMS	7
Olio per pietre	60	OP551X	32	SP5	50	<b>X</b> 123X	33
OP2C	36	OP661C	36	SP10	50	124X	33
OP2CT	42	OP661CT	42	SP11	50	125X	33
OP2X	33	OP661X	33	SP12	50	126X	33
OP3C	36	OR1	27	SP22	50	127X	33
OP3CT	42			SP24	50		
OP3DC	35	<b>P</b> P10	8	14SPY13S	11	<b>Z</b> ZA2	8
OP3DCT	41	P15	8			ZA3	8
OP3DX	32	P20	8	<b>T</b> Test sticks (6p.)	60	ZI8	6
OP3X	33	P96	8	1TH2	48	ZI8A	6
OP4	36	PD1	12	3TH4	48	ZI10	11
OP6C	36	PD2	12	5TH6	48	10ZI12	12
OP6CT	42	PDC11/12	16	7TH8	48	ZI11™	11
OP6X	33	PDC13/14	16	TH10	44	ZI11L	11
OP7DS	45	PDCF	16	TH26	40	ZI11R	11
OP22C	35	PDCU	16	TH27	40	11ZI12	12
OP22CT	41	PJ1	44	TH28C =TH28	39	ZI12	12
OP22X	33	PJ2	44	TH28CT	43	ZI13	27
OP26C	35	PJ4	39	TH28X	34	ZI15	13
OP26CT	41	5PM6 + ADEP	18	TH30	23	ZI15S	13
OP26X	32	7PM8 + ADEP	18	TH31	23	ZI15SS	14
OP27	44	11PM12 + ADEP	18	TH40	24		
OP27D	44	13PM14 + ADEP	18	TH41	24	ZI17	20
OP30C	36	PP12	6/7	TH66C	35	ZI18	20
OP31C	36	PP12DMS	6/7	TH66CT	41	ZI19	27
OP33C	36	PR1	28	TH66X	32	ZI51	45
OP33DC	35	PR1A	28	TI11L	16	ZI51A	44
OP33DCT	41	PR4	28	TI11LDMS	16	ZI52A	44
OP33DX	32	PR4A	28	TI11R	16	ZI53A	44
OP35	44	PR15	24	TI11RDMS	16	ZI54A	40
OP36	45	PR16	24	TI23A	13	ZI58A	44
OP36D	45	PS1	24	TI23AS	14	ZI62C	35
OP36L	44	PS2	28	TI67L	16	ZI62CT	42
OP36M	45	PY1	11	TI67LDMS	16	ZI62X	33
OP36MPC	38	14PY13	13	TI67R	16	ZI63C	36
OP36MPCT	43	PY15	11	TI67RDMS	16	ZI66C	35
OP36MPX	34	PY51Z™	11	TR15	11	ZI66CT	41
OP36P	44	PY51ZF	12			ZI66X	32
OP37	39/40	PY61	12	<b>V</b> VA1	52	ZI68	50
OP37D	40	PY67	40	VA2	52	ZI187	40
OP40	36	PY151	11	VA3	51		
OP43	45			VA4	51		
OP44	45	<b>R</b> RAO800	60	VA5	51		
OP46C	38	RZI11L	11	VA6	51		
OP46CT	43	RZI12L	12	VA7	54		
OP46DC	38			VA8	54		
OP46DCT	43	<b>S</b> S2	5	VA9	54		
OP46DX	34	S3A	5	VA10	54		
OP46X	34	S3C	5	VA11	■		
OP52	45	S3D	5	VA12	54		
OP52H	■	S5	5	VA13B	54		
OP54C	36	S5D	5	VA14	54		
OP54CT	42	S6	5	VA16	25		
OP54X	33	S8	5	VA17	25		
OP55C	35	S12	5	VA18	25		
OP55CT	41	S24	5	VA19	25		
OP55X	32	14S13	5	VA21	25		
OP58C	36	S17	5	VA22	54		
OP58CT	42	S23	5	VD8	40		
OP58X	33	S23H	5-51	VT1	23		
OP59	44	S66	5	VT2	23		
OP59D	44	SC5	11	VT3	23		
OP65P	54	Schleiföl	60	VT4	23		
OP70T	40	SE1	28	VT5	23		
OP80C	38	SE3	6	VT6	23		
OP80CT	43	SE4	6	VT7	23		
OP80PC	38	SE8	45	VT8	23		
OP80PCT	43	SE40	52	VT9	23		
OP80PX	34	SE60	52	VT22	24		
OP80X	34	SE80	52	VT23	24		
OP84	36	SG5	5-51	VT24	24		
OP90	44	1SJ2S	27	VT27	24		

■ n'est plus fabriqué  
nicht mehr hergestellt  
non è più fabbricato  
not manufactured anymore

**index alphabétique**  
**alphabetischer index**  
**indice alfabetico**  
**alphabetical index**

ADEP manchons en silicone	61	ADEP Silikon Hülsen	61	ADEP manicotti in silicone	61	ADEP Sleeves	61
Appareil à aiguiser	59	Atraumatic Gracey Küretten	18	Apicectomia strumenti	54	Apicectomy instruments	54
Applicateurs de chaleur	52	Chirurgische Küretten	25-26	Apparecchio affilatura	59	Atraumatic Gracey curettes	18
Atraumatic Gracey curettes	18	CLEANext Box	57	Atraumatic Gracey curettes	18	Ball pluggers	33/37/42
Bâtons test	60	Composite Instrumente	31-45	Bisturi paro	27	Bone chisels	27
Brucelles	8	Desmotome	23	Brunitoi a pallina	33/37/42	Bone scraper	27
Carvers	40	Easy-Sharp	59	Carvers	40	Carvers	40
Chirurgicales curettes	25-26	Endo Instrumente	51-54	Chirurgiche curettes	25-26	Chisels	46-48
Ciseaux bords gingivaux	47-48	Excavatoren	49-50	CLEANext Box	57	CLEANext Box	57
Ciseaux émail	46-48	Feilen Knochen	27	Composito, strumenti	31-45	Composite instruments	31-45
Ciseaux os	27	Feilen Zahnstein	20	Condensatori	52	Condensers	52
CLEANext Box	57	FG Silikon Hülsen	61	Cordino retrattore str.	53	Curettes, universal	13-14
Composite instr.	31-45	Furkations Küretten	14	Curette universali	13-14	Easy-Sharp	59
Condenseurs	52	Gracey Küretten	17-19/21	Easy-Sharp	59	Elevators	29
Couteaux gencive	27	Griffe	61	Endodontici strumenti	51-54	Endodontic instruments	51-54
Curettes universelles	13-14	Griffe Silikon	61	Escavatori	49-50	Excavators	49-50
Easy-Sharp	59	Hauen	20	FG manicotti in silicone	61	Explorers	5/45
Elevateurs	29	Heidemann Spatel	33/36/42	Forcazioni, curette	14	FG Sleeves	61
Endodontiques, instr.	51-54	Implantat Küretten	15-16	Gracey curette	17-19/21	Files, bone	27
Excavateurs	49-50	Knochenmeissel	27	Heidemann, spatole	33/36/42	Files, periodontal	20
FG manchons en silicone	61	Knochenschaber	27	Impianti, curette	15-16	Furcations curettes	14
Fouloirs	33/36/42	Kondensatoren	52	Langer, curette	13	Gingival cord layers	53
Fouloirs à boules	33/37/42	Kugelstopfer	33/37/42	Leve	29	Gracey curettes	17-19/21
Fouloirs à fils	53	Küretten, universal	13-14	Lime osso	27	Handles	61
Fouloir à mèche	28	Langer Küretten	13	Lime paro	20	Handles silicone	61
Fouloirs retro	54	Lingual Scalers	12	Linguale, scaler	12	Heat carriers	52
Furcations, curettes	14	Messer Gingival	27	Manici	61	Heidemann spatulas	33/36/42
Gracey curettes	17-19/21	Micro Spiegel	51	Manicotti silicone	61	Hoes	20
Heidemann, spatules	33/36/42	Mini Profil™ Gracey Küretten	18	Mini Profil™ Gracey curettes	18	Implant curettes	15-16
Houes	20	Modellier Instrumente	34/39/43	Modellazione, strumenti da	34/39/43	Langer curettes	13
Huile d'aiguisage	60	Mucotome	28	Mucotomi	28	Lingual scalers	12
Implants, curettes à	15-16	Nano Profil™ Gracey Küretten	19	Nano Profil™ Gracey curettes	19	Margin trimmers	47-48
Langer curettes	13	Papillen Elevator	24	Nitriro di titanio	41-43	Micro mirrors	51
Limes os	27	PerioDiaCurette	16	Olio affilatura	60	Mini Profil™ Gracey curettes	18
Limes paro	20	Periotome	23	Otturatori	33/36/42	Modelling instruments	34/39/43
Lingual scalers	12	Pinzetten	8	Otturatori retro	54	Mucotomes	28
Manches	61	Prichard	24	Papille, elevatore per	24	Nano Profil™ Gracey curettes	19
Manches silicone	61	Randfinierer	47-48	PerioDiaCurette	16	Papillaes elevator	24
Mini Profil™ Gracey curettes	18	Raspatorium	24	Periotomi	23	PerioDiaCurette	16
Miroirs micro	51	Retraktionsfaden Stopfer	53	Pietre affilatura	60	Periodontal knives	27
Modeler, instruments à	34/39/43	Retro-Stopfer	54	Pinzette	8	Periosteal elevators	24
Mucotomes	28	Scalers	9/11-12	Portatampone	28	Periotomes	23
Nano Profil™ Gracey curettes	19	Schleifgerät	59	Prichard	24	Pluggers	33/36/42
Nitrure de titane instr.	41-43	Schleiföl	60	Raschietto per osso	27	Plunger gauze	28
Papilles, élévateur à	24	Schleifsteine	60	Scaler	9/11-12	Prichard	24
PerioDiaCurette	16	Schmelzmesser	46-48	Scalpelli osso	27	Probes, endo	51
Periotome	23	Schnitzer	40	Scalpelli per margini	47-48	Probes, furcation	8
Pierres à aiguiser	60	Shadeline™ Instr.	32-34	Scatola sterilizzazione	57	Probes, implants	6-7
Prichard	24	Sinuslift	24	Scollaperiostio	24	Probes, pocket	6-7
Râcleur à os	27	Sonden	5/45	Shadeline™ strumenti	32-34	Retro pluggers	54
Raspatoires	24	Sonden, Furkationen	8	Sindesmotomi	23	Scalers	9/11-12
Résections apicales instr.	54	Sonden, Implantat	6-7	Sinuslift	24	Shadeline™ instruments	32-34
Scalers	9/11-12	Sonden, Paro	6-7	Sonda per impianti	6-7	Sharpening appliance	59
Shadeline™ instr.	32-34	Spatel	32/35/41	Sonde	5/45	Sharpening oil	60
Sinuslift	24	Spatel Zement	50	Sonde endodontiche	51	Sharpening stones	60
Sondes	5/45	Sterilisations-Kassette	57	Sonde forzazioni	8	Sinuslift	24
Sondes canaux radiculaires	51	Stopfer	33/36/42	Sonde parodontali	6-7	Spatulas	32/35/41
Sondes furcations	8	Stopfer Tampon	28	Spatole	32/35/41	Spatulas cement	50
Sondes parodontales	6-7	Teststäbchen	60	Spatole cemento	50	Sterilization box	57
Sonde pour implants	6-7	Titan Küretten	15-16	Specchietti micro	51	Surgical curettes	25-26
Spatules	32/35/41	Titan Nitrid Instrumente	41-43	Tagliasmalto	46-48	Syndesmotomes	23
Spatules ciment	50	Wärmeträger	52	Test bastoncini	60	Test sticks	23
Sterilisation, boite de	57	Wurzelheber	29	Titanio curettes	15-16	Titanium curettes	60
Syndesmotomes	23	Wurzelkanal Sonden	51	Trasmettitrice del calore	52	Titanium nitrid instr.	15-16
Titane curettes	15-16	Wurzelspitzen-resektion Instr.	54	Zappette	20	Tweezers	8

**comment commander  
wie bestelle ich  
come ordinare  
how to order**

***www.deppeler.ch***

**Contactez votre dépôt dentaire, tous nos partenaires sont listés sur notre site internet.**

**Kontaktieren Sie Ihr Dental Depot, alle unsere Partner finden Sie auf unserer Internet Seite.**

**Contattate il vostro distributore, tutti i nostri partner sono visibili sul nostro sito internet.**

**Contact your distributor, all our partners are listed on our internet site.**